

**GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA
FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DEL
VENETO**

**VERBALE DEL 11/02/2015
SECONDA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 11 del mese di febbraio dell'anno 2015, alle ore 9,15 presso la sede del Magazzino economico dell'Aziende Ospedaliera di Padova, sito in V.le della Navigazione interna, 38, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di Aghi e siringhe per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto, per la durata di tre anni, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 73 del 06/11/2014.

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 10 del 23/01/2015, risulta così composta:

• Presidente:

- Dr.ssa Daniela Barzan: Dirigente farmacista presso la Ulss n. 13 di Mirano;

• Componenti:

- Sig.ra Paola Battanolli: Coordinatore Infermieristico presso il di Dipartimento Emergenza Urgenza - U.O. ISTAR 2 – AO di Padova;
- Sig.ra Bertilla Ranzato: Coordinatore Infermieristico presso il Dipartimento Salute della Donna e del Bambino - Coordinatore U.O. Chirurgia Pediatrica – AO di Padova;
- Sig. Franco Martinello: Coordinatore Infermieristico presso la U.O. Nefrologia e Dialisi – AO di Padova;
- Sig. Nicola Galtarossa: Coordinatore Infermieristico presso la SC Oncologia medica 2 – IRCCS IOV;

svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante la dott.ssa Roberta Padovan, in servizio presso la Sezione Controlli Governo e Personale della Regione del Veneto.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Vengono ripresi i lavori della precedente seduta riservata del 4 febbraio 2015, come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.


La Commissione provvede preliminarmente all'approfondita lettura dell'Allegato 6 al Disciplinare di Gara, contenente gli elementi per la valutazione dell'offerta, LOTTO per LOTTO, al fine di procedere con la valutazione qualitativa dei prodotti dichiarati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara.

La Commissione procede, quindi, con la valutazione qualitativa dei prodotti, LOTTO per LOTTO.

LOTTO N. 24 - SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI DA TUBERCOLINA CON AGO STACCABILE

BENEFIS – preliminarmente alla valutazione qualitativa del prodotto, la Commissione scioglie la riserva in ordine alla conformità del prodotto offerto, riscontrando che la lunghezza degli aghi rispetta le misure prescritte nel Capitolato Tecnico.

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

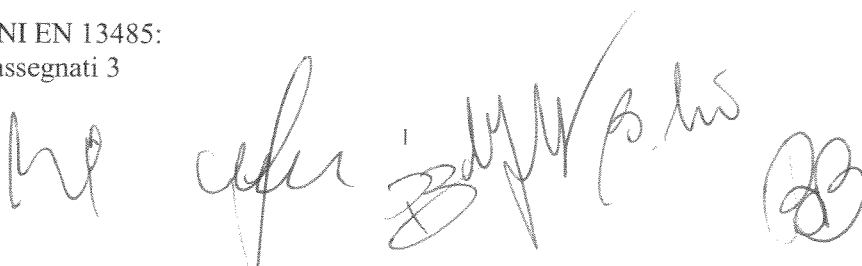

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:
ottima - punti assegnati 4
- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 5
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
ottima anche per la presenza di una graduazione dettagliata della capacità della siringa sulla scala -
punti assegnati 5
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 3
- Affilatura dell'ago intesa come penetrabilità:
ottima in quanto l'affilatura è lanceolata e pertanto atraumatica - punti assegnati 5
- Ergonomicità dell'impugnatura:
ottima - punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 3
- facilità di manovra di apertura:
buona - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
facile - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1


La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 39 punti

NACATUR –preliminarmente alla valutazione qualitativa del prodotto, la Commissione scioglie la riserva in ordine alla conformità del prodotto offerto, riscontrando che la lunghezza degli aghi rispetta le misure prescritte nel Capitolato Tecnico.

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:
ottima - punti assegnati 4
- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 5
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
buona - punti assegnati 3
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di rimozione del copriago:
insufficiente in quanto la manovra di rimozione del copriago risulta difficoltosa comportando, a volte, il distacco dell'ago - punti assegnati 0,5
- Affilatura dell'ago intesa come penetrabilità:
buona - punti assegnati 3
- Ergonomicità dell'impugnatura:
ottima - punti assegnati 4

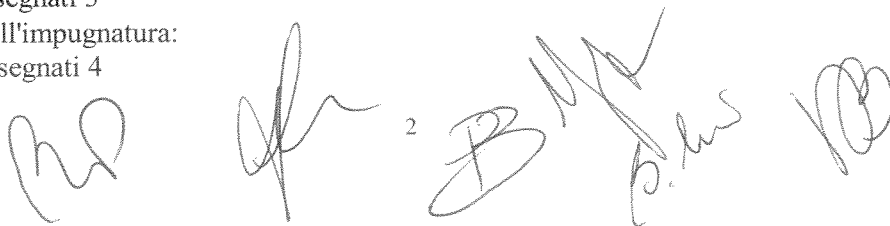

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
insufficiente poiché i caratteri di stampa sono poco leggibili e la data non è espressa in modalità giorno/mese/anno, con conseguente rischio di travisamento - punti assegnati 1
- facilità di manovra di apertura:
sufficiente - punti assegnati 1,5

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
estremamente difficoltosa la corretta identificazione del prodotto, in quanto non è indicata la lunghezza dell'ago e la descrizione del contenuto - punti assegnati 0
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
sufficiente in quanto la scatola risulta facilmente deformabile - punti assegnati 0,5

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 28,5 punti

LOTTO N. 25 - SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI DA TUBERCOLINA CON AGO STACCABILE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA

BENEFIS – - preliminarmente alla valutazione qualitativa del prodotto, la Commissione scioglie la riserva in ordine alla conformità del prodotto offerto, riscontrando che la lunghezza degli aghi rispetta le misure prescritte nel Capitolato Tecnico.

Viene rilevato, in sede di prova pratica, uno spazio morto che comporta il rischio di formazione di bolle d'aria e di spreco del farmaco infuso.

La Commissione rileva che l'anomalia sopra riscontrata costituisce una grave irregolarità del prodotto in quanto ne compromette l'efficace utilizzo.

La Commissione, unanimemente, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conforme alle caratteristiche tecniche previste il prodotto offerto dalla Ditta BENEFIS, che pertanto viene esclusa dal prosieguo della gara per il LOTTO N. 25.

Pertanto, considerato che la ditta predetta era l'unica offerente, il LOTTO 25 va dichiarato deserto.

LOTTO N. 26 - SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI CON AGO

✓ ***Sub A) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI CON AGO***


✓ ***Sub B) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI CON AGO***

BENEFIS – - preliminarmente alla valutazione qualitativa del prodotto, la Commissione scioglie la riserva in ordine alla conformità del prodotto offerto, riscontrando che la lunghezza degli aghi rispetta le misure prescritte nel Capitolato Tecnico.

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:
ottima - punti assegnati 4
- Scorrevolezza del pistone:

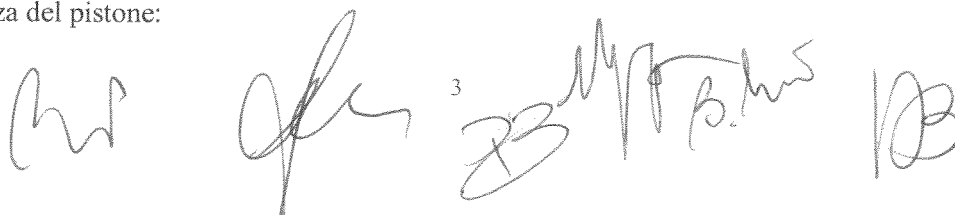 3

- ottima - punti assegnati 5
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
buona - punti assegnati 3
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 3
- Affilatura dell'ago intesa come penetrabilità:
ottima - punti assegnati 5
- Ergonomicità dell'impugnatura:
ottima - punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 3
- facilità di manovra di apertura:
buona, in quanto pur essendo agevole l'apertura, a volte la carta si rompe - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
facile - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 37 punti

RAYS --

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza


- Tenuta del gommino:
ottima - punti assegnati 4
- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 5
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
molto buona - punti assegnati 4
- Facilità di connessione e sconnessione:
buona - punti assegnati 2
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 3
- Affilatura dell'ago intesa come penetrabilità:
ottima - punti assegnati 5
- Ergonomicità dell'impugnatura:
ottima - punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
sufficiente visibilità di misure, lotto e scadenza in quanto i caratteri sono ridotti e pertanto poco leggibili - punti assegnati 1,5
- facilità di manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 3

Confezionamento Secondario:






- identificazione corretta del prodotto:
facile - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 36,5 punti

FARMAC ZABBAN - -

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:
ottima - punti assegnati 4
- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 5
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
ottima - punti assegnati 5
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 3
- Facilità di rimozione del copriago:
difficoltosa la rimozione del copriago - punti assegnati 1
- Affilatura dell'ago intesa come penetrabilità:
ottima - punti assegnati 5
- Ergonomia dell'impugnatura:
ottima - punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
buona visibilità di misure, lotto e scadenza ma non è indicata la lunghezza dell'ago - punti assegnati 1,5
- facilità di manovra di apertura:
l'apertura risulta difficoltosa e conseguentemente la carta si strappa - punti assegnati 1,5

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
sufficiente - punti assegnati 0,5
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
sufficiente in quanto la scatola risulta facilmente deformabile - punti assegnati 0,5

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 34 punti

NACATUR - - - preliminarmente alla valutazione qualitativa del prodotto, la Commissione scioglie la riserva in ordine alla conformità del prodotto offerto, riscontrando che la lunghezza degli aghi rispetta le misure prescritte nel Capitolato Tecnico.

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:
ottima - punti assegnati 4
- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 5

- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
buona - punti assegnati 3

- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 3

- Facilità di rimozione del copriago:
ottima - punti assegnati 3

- Affilatura dell'ago intesa come penetrabilità:
ottima - punti assegnati 5

- Ergonomia dell'impugnatura:
ottima - punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
insufficiente in quanto la data non è espressa in modalità giorno/mese/anno, con conseguente rischio di travisamento, e non è indicata la lunghezza dell'ago - punti assegnati 1
- facilità di manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 3

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
insufficiente in quanto risulta difficoltosa la lettura del contenuto – punti assegnati 0
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
insufficiente in quanto la scatola, troppo morbida, si deforma facilmente - punti assegnati 0,5

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 34,5 punti.

• LOTTO N. 27 - SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO

- ✓ **Sub A) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO** – Misure siringhe da 2 - 2,5 ml cono centrale luer
- ✓ **Sub B) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO** – Misure siringhe da 5 ml cono centrale/eccentrico luer
- ✓ **Sub C) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO** – Misure siringhe da 10 ml cono eccentrico/centrale luer
- ✓ **Sub D) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO** – Misure siringhe da 20 ml. cono eccentrico luer
- ✓ **Sub E) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO** – Misure siringhe da 30 ml. cono eccentrico luer
- ✓ **Sub F) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO** – Misure siringhe da 50 ml cono eccentrico luer

BENEFIS – -

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:
buona - punti assegnati 3
- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 4
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
ottima - punti assegnati 5
- Facilità di connessione e sconnessione:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

- molto buona - punti assegnati 4
- Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione:
ottima - punti assegnati 7
- Ergonomicità dell'impugnatura:
ottima - punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 3
- facilità di manovra di apertura:
buona in quanto a volte si rompe la carta durante la manovra di apertura - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
facile - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 37 punti

RAYS –

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:
ottima - punti assegnati 4
- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 4
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
molto buona - punti assegnati 4
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 5
- Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione:
ottima - punti assegnati 7
- Ergonomicità dell'impugnatura:
ottima - punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
insufficiente visibilità di misure, lotto e scadenza in quanto i caratteri sono ridotti e pertanto poco leggibili - punti assegnati 1
- facilità di manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 3

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
facile - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 37 punti

NACATUR --

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:
sufficiente in quanto il gommino presenta, per le siringhe di volume più elevato, una scarsa tenuta -
punti assegnati 2
- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 4
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
molto buona - punti assegnati 4
- Facilità di connessione e sconnessione:
molto buona - punti assegnati 4
- Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione:
ottima - punti assegnati 7
- Ergonomia dell'impugnatura:
ottima - punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
buona la visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 2
- facilità di manovra di apertura:
insufficiente in quanto, con riferimento al lotto sub F) l'apertura avviene in corrispondenza del cono della siringa e non dello stantuffo, con conseguente rischio di inquinamento della siringa stessa -
punti assegnati 0

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
insufficiente in quanto risulta difficoltosa la lettura del contenuto – punti assegnati 0
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
insufficiente in quanto la scatola, troppo morbida, si deforma facilmente - punti assegnati 0

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 30 punti

LOTTO N. 28 - SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO CATETERE

✓ Sub A) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO CATETERE –

Misure siringhe da 50/60 ml cono catetere non a becco di flauto

✓ Sub B) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO CATETERE –

Misure siringhe da 100 ml cono catetere non a becco di flauto

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

BENEFIS – -

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:
ottima - punti assegnati 4
- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 4
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:

hp 8 BB WPS B. S. MB

- ottima - punti assegnati 5
- **Facilità di connessione e sconnessione:**
ottima - punti assegnati 5
- **Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione:**
ottima - punti assegnati 7
- **Ergonomia dell'impugnatura:**
sufficiente - punti assegnati 2

Confezionamento Primario:

- **Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:**
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 3
- **facilità di manovra di apertura:**
ottima - punti assegnati 3

Confezionamento Secondario:

- **identificazione corretta del prodotto:**
facile - punti assegnati 1
- **facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):**
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 38 punti

RAYS –

- **Certificazione UNI EN 13485:**
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- **Tenuta del gommino:**
ottima - punti assegnati 4
- **Scorrevolezza del pistone:**
ottima - punti assegnati 4
- **Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:**
ottima - punti assegnati 5
- **Facilità di connessione e sconnessione:**
ottima - punti assegnati 5
- **Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione:**
ottima - punti assegnati 7
- **Ergonomia dell'impugnatura:**
sufficiente - punti assegnati 2

Confezionamento Primario:

- **Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:**
buona visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 2
- **facilità di manovra di apertura:**
buona - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- **identificazione corretta del prodotto:**
facile - punti assegnati 1
- **facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):**
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 36 punti

FARMAC ZABBAN – -

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:
ottima - punti assegnati 4
- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 4
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
ottima - punti assegnati 5
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 5
- Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione:
ottima - punti assegnati 7
- Ergonomicità dell'impugnatura:
ottima - punti assegnati 4

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 3
- facilità di manovra di apertura:
buona - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
difficoltosa l'identificazione del prodotto in quanto i caratteri sono ridotti e le informazioni relative al contenuto sono riportate solo su un lato della confezione - punti assegnati 0,5
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 38,5 punti

NACATUR – -

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:
buona - punti assegnati 3
- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 4
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
ottima - punti assegnati 5
- Facilità di connessione e sconnessione:
ottima - punti assegnati 5
- Tenuta della connessione con sistemi di infusione o irrigazione:
ottima - punti assegnati 7
- Ergonomicità dell'impugnatura:
sufficiente - punti assegnati 2

Handwritten signatures and a stamp. The stamp is a circular official seal with the number '10' in the center. There are several cursive signatures around and over the stamp.

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 3
- facilità di manovra di apertura:
insufficiente in quanto la carta si rompe durante la manovra di apertura - punti assegnati 1

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
particolarmente difficoltosa l'identificazione del prodotto in quanto i caratteri sono molto ridotti e pertanto no leggibili - punti assegnati 0
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
insufficiente in quanto la scatola, troppo morbida, si deforma facilmente - punti assegnati 0

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 33 punti

LOTTO N. 29 - SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO SENZA CONO CON AGO FISSO

- ✓ **Sub A) SIRINGHE DA INSULINA SENZA CONO CON AGO FISSO** – Misure siringhe 0,3 ml. ago 29 /30 G lunghezza ago da circa 8 mm a circa 13 mm
- ✓ **Sub B) SIRINGHE DA INSULINA SENZA CONO CON AGO FISSO** – Misure siringhe 0,5 ml ago 29 /30 G lunghezza ago da circa 8 mm a circa 13 mm
- ✓ **Sub C) SIRINGHE DA INSULINA SENZA CONO CON AGO FISSO – CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA** 0,5 ml – ago 29/30 G lunghezza ago da circa 8 mm a circa 13 mm

FARMAC ZABBAN – -

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza


- Tenuta del gommino:
ottima - punti assegnati 4
- Scorrevolezza del pistone:
buona in quanto il pistone risulta a volte troppo scorrevole - punti assegnati 3
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
ottima - punti assegnati 6
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima – punti assegnati 3
- Affilatura dell'ago intesa come penetrabilità:
ottima – punti assegnati 6
- Presenza della mezza unità:
assente – punti assegnati 0
- Resistenza dell'ago alla deformazione:
ottima – punti assegnati 5

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 2
- facilità di manovra di apertura:
ottima - punti assegnati 2

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:

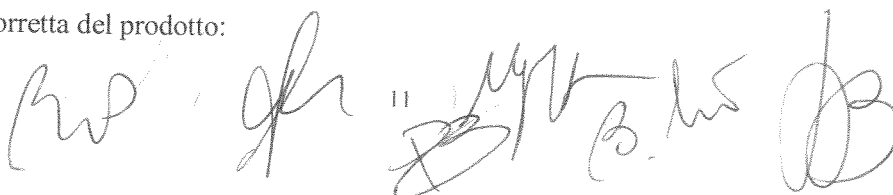

- facile - punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
ottima in relazione a dimensioni e consistenza dell'imballo - punti assegnati 1

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 36 punti

PROMED – -

- Certificazione UNI EN 13485:
presente - punti assegnati 3

Funzionalità e maneggevolezza

- Tenuta del gommino:
ottima - punti assegnati 4
- Scorrevolezza del pistone:
ottima - punti assegnati 4
- Visibilità della scala graduata e trasparenza del cilindro:
ottima - punti assegnati 6
- Facilità di rimozione del copriago:
ottima – punti assegnati 3
- Affilatura dell'ago intesa come penetrabilità:
ottima – punti assegnati 6
- Presenza della mezza unità:
presente nella siringa di cui al lotto 29 sub A) – punti assegnati 3
- Resistenza dell'ago alla deformazione:
ottima – punti assegnati 5

Confezionamento Primario:

- Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili:
ottima visibilità di misure, lotto e scadenza - punti assegnati 2
- facilità di manovra di apertura:
presenza di confezione multidose che, una volta aperta, può compromettere la corretta identificazione del lotto e della scadenza da parte dell'utilizzatore - punti assegnati 0

Confezionamento Secondario:

- identificazione corretta del prodotto:
facile (sulla base della fotocopia dell'etichetta del confezionamento secondario, acclusa al campione) -
punti assegnati 1
- facilità di stoccaggio (dimensioni e consistenza imballo):
assente l'imballo secondario - punti assegnati 0

La Commissione, unanimemente, assegna il seguente punteggio complessivo: 37 punti

LOTTO N. 30 - SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO

- ✓ Sub A) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO – Misure siringhe da 2 - 3 ml
- ✓ Sub B) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO – Misure siringhe da 5 ml
- ✓ Sub C) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO – Misure siringhe da 10 ml
- ✓ Sub D) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO – Misure siringhe da 20 ml
- ✓ Sub E) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO – Misure siringhe da 30 ml

12

- ✓ **Sub F) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK
A TRE PEZZI SENZA AGO – Misure siringhe da 50 ml**
- ✓ **Sub G) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK
A TRE PEZZI SENZA AGO – Misure siringhe da 50 ml ambrate**

NACATUR – -

In relazione al LOTTO in esame, la Commissione decide, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare di gara, di richiedere campionatura integrativa per il **LOTTO 3 Sub G) SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO – Misure siringhe da 50 ml ambrate**.

La valutazione dell'intero LOTTO 30 viene rinviata alla prossima seduta, previa ricezione della campionatura integrativa di cui sopra.

Alle ore 14,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori al giorno 26/02/2015 alle ore 9,00 presso la sede del Magazzino Economale della AO di Padova, situato in V.le Navigazione Interna n. 38 – Padova, ove sono custoditi i campioni presentati dalle Ditte, per procedere con la valutazione qualitativa dei prodotti ammessi, Lotto per Lotto, desumibile dalla documentazione tecnica e dai campioni presentati, secondo i parametri di valutazione previsti nell'Allegato 6 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Dott.ssa Daniela Barzan


I COMPONENTI: Sig.ra Paola Battanolli

Sig.ra Bertilla Ranzato

Sig. Franco Martinello

Sig. Nicola Galtarossa

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Roberta Padovan

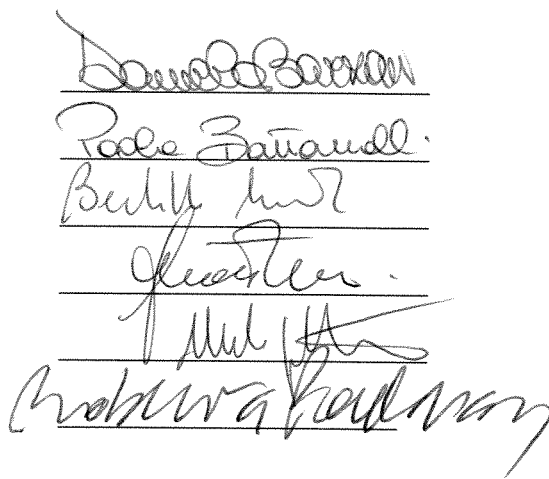

The block contains five handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: Daniela Barzan, Paola Battanolli, Bertilla Ranzato, Franco Martinello, and Nicola Galtarossa. The signature of Roberta Padovan is not present in this block.

