

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI STENT CORONARICI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO.

**VERBALE DEL 2 APRILE 2014
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 2 del mese di aprile dell'anno 2014, alle ore 9.30 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara a procedura aperta per la fornitura, mediante accordo quadro, di Stent coronarici in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto approvata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 56 del 30.10.2013.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 4 del 15.01.2014, risulta così composta:

- Presidente: Prof. Corrado Vassanelli Direttore Unità Operativa di Cardiologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona,
- Componente: Dott.ssa Daniela Barzan Direttore Unità Operativa Farmacia Ospedaliera dell'Azienda Ulss 13 di Mirano,
- Componente: Dott. Paolo Cardaioli Responsabile Servizio di Diagnostica ed Interventistica Cardiovascolare dell'Azienda Ulss 18 di Rovigo,
- Componente: Dott. Zoran Olivari Direttore Dipartimento Cardio Vascolare dell'Azienda Ulss 9 Treviso,
- Componente: Dott. Giuseppe Tarantini Unità Operativa di Cardiologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova – Responsabile regionale del Veneto per la Società Italiana di Cardiologia Invasiva (GISE).

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lisa Brazzorotto, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta riprendendo i lavori della precedenti sedute riservate del 4 febbraio 2014 e del 18 marzo 2014 come da relativi verbali, che qui devono intendersi integralmente richiamati.

La Commissione prosegue, nella seduta odierna, nella valutazione delle offerte e nell'attribuzione dei relativi punteggi.

 pag. 1/1

LOTTO 2 – STENT CORONARICO IN LEGA METALLICA A RILASCIO DI FARMACO

In relazione ai prodotti presentati dalle Ditte ammesse per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue con riferimento alle sotto indicate ditte.

Boston Scientific S.p.A.

Prodotto: PROMUS PREMIER

Forza radiale: viene valutata anche considerando il recoil pari a 3%.

Grado di flessibilità e conformabilità alla parete del vaso: ottimo

Profilo d'ingresso: pari a 0,018''.

Diametro degli spazi tra maglie e spessore maglie: diametro massimo della cella espansa pari a 5,7 mm, spessore da 0,0032''.

Letteratura scientifica, certificazioni FDA, HTA: presenta adeguata letteratura ma un numero ridotto di marchi CE per specifica tipologia di pazienti.

Confezionamento e labeling: ottimo.

Medtronic Italia S.p.A.

Prodotto: RESOLUTE INTEGRITY

Forza radiale: viene valutata anche considerando il recoil pari a 4,2 % e l'indicazione in scheda tecnica di "elevata forza radiale".

Grado di flessibilità e conformabilità alla parete del vaso: ottimo

Profilo d'ingresso: pari a 0,019''.

Diametro degli spazi tra maglie e spessore maglie: area di cella al diametro nominale varia da 0,90 a 1 mm² in funzione del diametro, spessore da 0,0036''.

Letteratura scientifica, certificazioni FDA, HTA: presenta numerosa letteratura.

Confezionamento e labeling: ottimo.

Abbott Vascular Knoll Ravizza S.p.A.

Prodotto: XIENCE PRO e XIENCE PROX

Forza radiale: 937 mm Hg.

Grado di flessibilità e conformabilità alla parete del vaso: buono

Profilo d'ingresso: da 0,021'' a 0,0171''

Diametro degli spazi tra maglie e spessore maglie: diametro 1,14 mm, spessore da 0,0032''.

Letteratura scientifica, certificazioni FDA, HTA: presenta numerosa letteratura.

Confezionamento e labeling: ottimo.

La Commissione, sulla scorta dei dati tecnici rilevati, attribuisce i punteggi relativi alla qualità nei termini indicati nella sottostante tabella:

pag. 2

Tabella punteggi lotto 2

		Boston Scientific S.p.A.	Medtronic Italia S.p.A.	Abbott Vascular Knoll Ravizza S.p.A.
Criteri	Punteggio Max attribuibile	<i>nome commerciale: PROMUS PREMIER</i>	<i>nome commerciale: RESOLUTE INTEGRITY</i>	<i>nome commerciale: XIENCE PRO e XIENCE PRO X</i>
Forza radiale	7	7	6	6
Grado di flessibilità e conformabilità alla parete del vaso	7	7	7	5
Profilo di ingresso	7	7	7	7
Diametro degli spazi tra maglie e spessore maglie	7	7	6	7
Letteratura scientifica, certificazioni FDA, HTA	10	7	10	10
Confezionamento e labeling	2	2	2	2
Totale punteggio qualità	40	37	38	37

Nell'impossibilità di concludere i lavori, alle ore 13.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9.30 del giorno 18.04.2014 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire l'attività di valutazione.

Il Presidente della Commissione conserva le Buste 2 "Documentazione Tecnica" e la campionatura dei concorrenti in idoneo locale, chiuso a chiave e protetto, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE: Prof. Corrado Vassanelli

I COMPONENTI: Dott.ssa Daniela Barzan

Dott. Paolo Cardaioli

Dott. Zoran Olivari

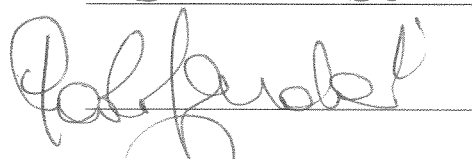


IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

Dott. Giuseppe Tarantini

Dott.ssa Lisa Brazzorotto

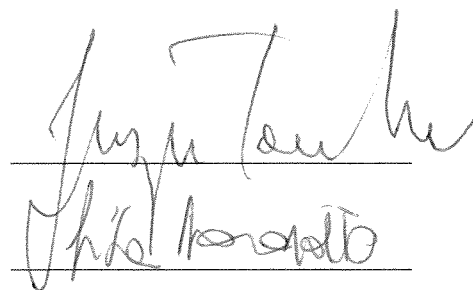

Handwritten signatures of Giuseppe Tarantini and Lisa Brazzorotto, each on a horizontal line.