

**GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MEDICAZIONI SPECIALI (LOTTI NN. 14 – 28 – 29) IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO**

**VERBALE DEL 27.09.2013  
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 27 del mese di settembre dell'anno 2013, alle ore 9.45 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla procedura aperta per la fornitura triennale di medicazioni speciali (lotti nn. 14 – 28 -29) in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 44 del 23.09.2013 risulta così composta:

- Presidente: Dott.ssa Daniela Barzan      Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera dell'Azienda Ulss 13 di Mirano,
- Componente: Dott. Bruno Azzena      Dirigente Medico Responsabile U.O.S. Centro Ustioni dell'Azienda Ospedaliera di Padova,
- Componente: Dott. Alberto Cester      Direttore del Dipartimento di Geriatria, Lungodegenza e Riabilitazione dell'Azienda Ulss 13 di Mirano,
- Componente: Dott.ssa Deborah Tormena      Infermiera ADI dell'Azienda Ulss 2 di Feltre,
- Componente: Sig. Dalmazio Vedelago      Infermiere Terapia Intensiva Cardiochirurgica dell'Azienda Ulss 9 di Treviso.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lisa Brazzorotto, Assistente Amministrativo del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che, in esito alla seduta pubblica di gara in data 24.09.2013 i seguenti candidati sono stati ammessi al prosieguo della gara, a seguito del riscontro positivo della documentazione amministrativa presentata dai medesimi a corredo dell'offerta, come risulta dai verbali dell'Ufficiale Rogante dei quali viene data lettura:

- 1) Pietrasanta Pharma S.p.A. con sede in Viareggio (LU)
- 2) Eurofarm S.p.A. con sede in Piano Tavola (CT)
- 3) Luigi Salvadori S.p.A. con sede in Scandicci (FI)
- 4) Molnlycke HealthCare S.r.l. con sede in Gallarate (VR)
- 5) Paul Hartmann S.p.A. con sede in Verona
- 6) 3M Italia S.p.A. con sede in Pioltello (MI)
- 7) Smith&Nephew S.r.l. con sede in Agrate Brianza (MB)



pag. 1

- 8) Varimed S.r.l. con sede in Catania
- 9) Artsana S.p.A. con sede in Grandate (CO)
- 10) PharmaGIC s.r.l. con sede in ROMA
- 11) Farmac-Zabban S.p.A. con sede in Calderara di Reno (BO)

Il Presidente, quindi, consegna alla Commissione le Buste 2 "Documentazione Tecnica" dei quindici concorrenti ammessi, custodite - unitamente ai plichi riportanti all'esterno la dicitura "CAMPIONATURA GARA REGIONALE PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MEDICAZIONI SPECIALI (LOTTI NN. 14 - 28 - 29) IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO - LOTTO/I \_\_\_\_\_ - NON APRIRE" - in luogo sicuro e protetto, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

La Commissione, preliminarmente alla disamina della documentazione contenuta nelle buste B, procede con una approfondita lettura del "Disciplinare di Gara" e dei relativi "ALLEGATO 4 al disciplinare - Capitolato Tecnico" e "ALLEGATO 5 - Elementi per la valutazione dell'offerta", al fine di valutare i prodotti ammessi sotto il profilo della conformità dei medesimi ai requisiti ivi prescritti.

La Commissione procede, quindi, con la disamina della documentazione tecnica contenuta nelle buste B delle ditte ammesse, LOTTO per LOTTO, e con la valutazione di conformità dei prodotti offerti alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara.

#### **LOTTO 14 MEDICAZIONE IN POLIURETANO TRASPARENTE**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Eurofarm S.p.A. conforme
- Molnlycke HealthCare S.r.l. conforme
- Paul Hartmann S.p.A. conforme
- 3M Italia S.p.A. conforme
- Smith&Nephew S.r.l. per il lotto sub b) la scheda tecnica del prodotto presenta fra le indicazioni "*fissaggio di cateteri periferici, centrali, epidurali e pediatrici e applicazioni PICC line*", mentre fra le controindicazioni l'utilizzo "*per ferite aperte come le ulcere da pressione, le ustioni o le sedi di innesti cutanei*".
- Farmac-Zabban S.p.A. conforme

La Commissione, per le motivazioni di cui sopra, dichiara non conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di gara il prodotto offerto dalla ditta Smith&Nephew S.r.l.

La ditta Smith&Nephew S.r.l., pertanto, viene esclusa dal prosieguo della gara con riferimento al prodotto offerto per il lotto n. 14.

## **LOTTO 28 – CEROTTO A NASTRO IN SETA**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta ammessa, al fine di valutare la conformità del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Pietrasanta Pharma S.p.A.      conforme
- Eurofarm S.p.A.                    conforme
- Luigi Salvadori S.p.A.            conforme
- Paul Hartmann S.p.A.            conforme
- Varimed S.r.l.                        conforme
- Artsana S.p.A.                        conforme
- PharmaGIC s.r.l.                     conforme
- Farmac-Zabban S.p.A.            conforme

## **LOTTO 29 – CEROTTO A NASTRO IN TELA**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- Pietrasanta Pharma S.p.A.      conforme
- Eurofarm S.p.A.                    conforme
- Luigi Salvadori S.p.A.            conforme
- Paul Hartmann S.p.A.            conforme
- Varimed S.r.l.                        conforme
- Artsana S.p.A.                        conforme
- PharmaGIC s.r.l.                     conforme
- Farmac-Zabban S.p.A.            conforme

La Commissione procede, quindi, all'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Ditte ammesse, al fine di valutare l'effettiva conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Tecnico, alla valutazione qualitativa secondo i parametri dettagliati nell'ALLEGATO 5 al disciplinare – Elementi per la valutazione dell'offerta e, infine, all'attribuzione dei relativi punteggi.



pag. 3

## LOTTO 14 MEDICAZIONE IN POLIURETANO TRASPARENTE

In relazione al prodotto presentato dalla Ditta ammessa per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

### **Eurofarm S.p.A.**

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Grado di traspirabilità espresso in MVTR (Moisture Vapore Transmission Rate): 1800 g/m<sup>2</sup>/24h

Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione): la presenza di alette laterale rende difficile il posizionamento e favorisce l'arricciamento durante il posizionamento.

Stabilità della medicazione in situ (capacità della medicazione di mantenere la posizione di applicazione senza distacchi accidentali/arricciamenti per attrito o sfregamento): sufficiente.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: buona.

Assenza di collanti sulla cute dopo rimozione: ottima.

Misura reale della medicazione: ottima.

Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto: pur se presente un'idonea apertura peel open, risulta poco intuitiva l'apertura, difficile la rimozione delle alette ai fini del corretto posizionamento.

### **Molnlycke HealthCare S.r.l.**

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Grado di traspirabilità espresso in MVTR (Moisture Vapore Transmission Rate): 1160 /m<sup>2</sup>/24h.

Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione): ottima.

Stabilità della medicazione in situ (capacità della medicazione di mantenere la posizione di applicazione senza distacchi accidentali/arricciamenti per attrito o sfregamento): ottima.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: ottima

Assenza di collanti sulla cute dopo rimozione: ottima

Misura reale della medicazione: ottima

Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto: ottima

### **Paul Hartmann S.p.A.**

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Grado di traspirabilità espresso in MVTR (Moisture Vapore Transmission Rate): 1100 gr/m<sup>2</sup>/24h.


Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione): ottima.

Stabilità della medicazione in situ (capacità della medicazione di mantenere la posizione di applicazione senza distacchi accidentali/arricciamenti per attrito o sfregamento): ottima.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: ottima.

Assenza di collanti sulla cute dopo rimozione: ottima.

Misura reale della medicazione: ottima.



pag. 4

Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto: ottima.

### **3M Italia S.p.A.**

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Grado di traspirabilità espresso in MVTR (Moisture Vapore Transmission Rate): 1420 gr/m<sup>2</sup>/24h.

Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione): ottima.

Stabilità della medicazione in situ (capacità della medicazione di mantenere la posizione di applicazione senza distacchi accidentali/arricciamenti per attrito o sfregamento): ottima.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: ottima.

Assenza di collanti sulla cute dopo rimozione: ottima.

Misura reale della medicazione: ottima.

Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto: ottima.

### **Farmac-Zabban S.p.A.**

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Grado di traspirabilità espresso in MVTR (Moisture Vapore Transmission Rate): 900 ± 200 gr/m<sup>2</sup>/24h.

Conformabilità (adattabilità alla zona di applicazione): i supporti cartacei della medicazione sono leggermente rigidi e poco intuitivi nell'apertura e la conformabilità non risulta ottimale.

Stabilità della medicazione in situ (capacità della medicazione di mantenere la posizione di applicazione senza distacchi accidentali/arricciamenti per attrito o sfregamento): molto buona.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: buona.

Assenza di collanti sulla cute dopo rimozione: presenta leggero residuo.

Misura reale della medicazione: ottima.

Apertura peel open o altra idonea apertura per garantire la sterilità del singolo prodotto: invito leggermente difficoltoso e difficile da trovare. Il confezionamento primario tende a rompersi.

### **LOTTO 28 – CEROTTO A NASTRO IN SETA**

In relazione al prodotto presentato dalla Ditta ammessa per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

#### **Pietrasanta Pharma S.p.A.**

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.


Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità: presente solo in scheda tecnica indicazione “particolarmente indicato per pelli delicate, sensibili e irritate”.

Facilità di strappo (sia in senso longitudinale che in senso verticale): si sfilaccia allo strappo sia in senso verticale che longitudinale.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: molto buona.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): ottima.

Indicatore di srotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento): molto buono.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are four distinct marks: a stylized signature, a signature that appears to be 'Zabban', a signature that appears to be 'Pietrasanta', and a circular stamp or signature with the text 'pag. 5' written inside it.

### **Eurofarm S.p.A.**

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità: dichiara test di irritazione cutanea e di sensibilizzazione allergica.

Facilità di strappo (sia in senso longitudinale che in senso verticale): ottima.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: ottima.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): ottima.

Indicatore di srotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento): molto buono.

### **Luigi Salvadori S.p.A.**

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità: dichiara test di irritazione cutanea e di sensibilizzazione allergica.

Facilità di strappo (sia in senso longitudinale che in senso verticale): ottima.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: molto buona.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): non ottimale in quanto l'assenza del rocchetto la rende più deteriorabile.

Indicatore di srotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento): molto buono.

### **Paul Hartmann S.p.A.**

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità: dichiara test di irritazione cutanea e di sensibilizzazione allergica.

Facilità di strappo (sia in senso longitudinale che in senso verticale): ottima.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: ottima.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): ottima.

Indicatore di srotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento): ottimo, inoltre il rocchetto è confezionato singolarmente preservandone l'utilizzo.

### **Varimed S.r.l.**

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità: presente solo in scheda tecnica dichiarazione di ipoallergenicità.

Facilità di strappo (sia in senso longitudinale che in senso verticale): ottima.


Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: non dà dolore ma non presenta un'adeguata adesività.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): presentando scarsa adesività è poco adattabile.

Indicatore di srotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento): molto buono.

### **Artsana S.p.A.**

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.



Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità: dichiara test di irritazione cutanea e di sensibilizzazione allergica.

Facilità di strappo (sia in senso longitudinale che in senso verticale): si sfilaccia allo strappo sia in senso verticale che longitudinale.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: molto buona.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): ottima.

Indicatore di srotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento): molto buono.

### **PharmaGIC s.r.l.**

Presenta la misura cm 5 anziché la misura cm 2,5 come richiesto dal capitolato tecnico.

**La ditta PharmaGIC s.r.l., pertanto, viene esclusa dal prosieguo della gara con riferimento al prodotto offerto per il lotto n. 28.**

### **Farmac-Zabban S.p.A.**

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità: dichiara test di irritazione cutanea e di sensibilizzazione allergica.

Facilità di strappo (sia in senso longitudinale che in senso verticale): si sfilaccia lievemente allo strappo sia in senso verticale che longitudinale.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: non dà dolore ma non presenta un'adeguata adesività.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): presentando scarsa adesività è poco adattabile.

Indicatore di srotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento): molto buono.

### **LOTTO 29 – CEROTTO A NASTRO IN TELA**

In relazione al prodotto presentato dalla Ditta ammessa per il LOTTO in esame, la Commissione rileva quanto segue:

### **Pietrasanta Pharma S.p.A.**

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità: presente solo in scheda tecnica indicazione “particolarmente indicato per pelli delicate, sensibili e irritate”.

Facilità di strappo: ottima.


Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: ottima

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): ottima.

Indicatore di srotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento): ottimo.

### **Eurofarm S.p.A.**

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.



Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità: dichiara test di irritazione cutanea e di sensibilizzazione allergica.

Facilità di strappo: ottima.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: molto buona.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): molto buona

Indicatore di srotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento): ottimo.

### **Luigi Salvadori S.p.A.**

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità: dichiara test di irritazione cutanea e di sensibilizzazione allergica.

Facilità di strappo: appena sufficiente.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: non dà dolore ma non presenta un'adeguata adesività.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): presentando scarsa adesività è poco adattabile.

Indicatore di srotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento): difficile trovare il punto di srotolamento, inoltre il rocchetto si smonta molto facilmente.

### **Paul Hartmann S.p.A.**

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità: dichiara test di irritazione cutanea e di sensibilizzazione allergica.

Facilità di strappo: buona.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: molto buona.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): molto buona.

Indicatore di srotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento): ottimo.

### **Varimed S.r.l.**

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità: presente solo in scheda tecnica dichiarazione di ipoallergenicità.

Facilità di strappo: buona.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: non dà dolore ma non presenta un'adeguata adesività.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): presentando scarsa adesività è poco adattabile.


Indicatore di srotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento): ottimo.

### **Artsana S.p.A.**

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità: dichiara test di irritazione cutanea e di sensibilizzazione allergica.

Facilità di strappo: buona.



pag. 8

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: non dà dolore ma non presenta un'adeguata adesività.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): presentando scarsa adesività è poco adattabile.

Indicatore di srotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento): ottimo.

### **PharmaGIC s.r.l.**

Presenta la misura cm 5 anziché la misura cm 2,5 come richiesto dal capitolato tecnico.

**La ditta PharmaGIC s.r.l., pertanto, viene esclusa dal prosieguo della gara con riferimento al prodotto offerto per il lotto n. 29.**

### **Farmac-Zabban S.p.A.**

Presenta la campionatura richiesta da capitolato tecnico.

Composizione della massa adesiva e idonea dichiarazione di ipoallergenicità: dichiara test di irritazione cutanea e di sensibilizzazione allergica.

Facilità di strappo: buona.

Facilità di rimozione anche finalizzata alla limitazione del dolore procedurale: non dà dolore ma non presenta un'adeguata adesività.

Facilità di applicazione (morbidezza, adattabilità): presentando scarsa adesività è poco adattabile.

Indicatore di srotolamento (facilità di trovare il punto di srotolamento): ottimo.

La Commissione procede quindi, all'attribuzione dei punteggi sulla base delle valutazioni qualitative effettuate, secondo i punteggi dettagliati nell'ALLEGATO 5 al disciplinare – Elementi per la valutazione dell'offerta.

I punteggi attribuiti vengono riepilogati nell'Allegato al presente verbale.

Alle ore 14.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente, quindi, trattiene presso di sé la documentazione contenuta nelle Buste "Documentazione Tecnica" delle Ditte concorrenti e la campionatura per custodirle in luogo sicuro e protetto presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova.


Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Dott.ssa Daniela Barzan

I COMPONENTI: Dott. Bruno Azzena


Dott. Alberto Cester

Dott.ssa Deborah Tormena




The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to Daniela Barzan, Bruno Azzena, Alberto Cester, and Deborah Tormena.

Sig. Dalmazio Vedelago

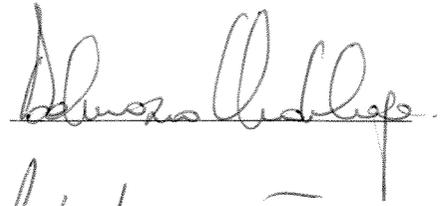Handwritten signature of Dalmazio Vedelago in black ink, written over a horizontal line.

IL SEGRETARIO  
VERBALIZZANTE

Dott.ssa Lisa Brazzorotto

Handwritten signature of Dott.ssa Lisa Brazzorotto in black ink, written over a horizontal line.