

GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO

VERBALE DEL 4 NOVEMBRE 2014
III^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 4 del mese di novembre dell'anno 2014, alle ore 9.15 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara, mediante procedura aperta, per la fornitura di reti chirurgiche in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto approvata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 32 del 20.05.2014.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 54 del 12.09.2014, risulta così composta:

- | | |
|--|---|
| - Presidente: Avv. Nicola De Conti | Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, |
| - Componente: Dott. Ferdinando Agresta | Responsabile U.O. di Chirurgia dell'Azienda Ulss 19 di Adria, |
| - Componente: Dott. Enrico Cian | Responsabile U.O. di Chirurgia Generale dell'Azienda Ulss 2 di Feltre, |
| - Componente: Dott.ssa Chiara Filippi | Dirigente Farmacista presso la Farmacia Ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, |
| - Componente: Dott. Pierluigi Pilati | Responsabile U.O. Chirurgia dell'Azienda Ulss 16 di Padova. |

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lisa Brazzorotto, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta riprendendo i lavori delle precedenti sedute riservate del 21.10.2014 e del 23.10.2014, come da relativi verbali, che qui devono intendersi integralmente richiamati.

La Commissione prosegue, nella seduta odierna, con la disamina della documentazione tecnica contenuta nelle buste 2 delle ditte ammesse, LOTTO per LOTTO, nonché della relativa campionatura, al fine di valutare i prodotti ammessi sotto il profilo della conformità dei medesimi ai requisiti prescritti e proseguire con la valutazione qualitativa.

LOTTO 13 – RETE PER TRATTAMENTO DELL'ERNIA IATALE, ANCHE PER VIA LAPAROSCOPICA, CON LATO ANTIADERENZIALE PER IL CONTATTO CON I VISCERI:
Varie misure.

Bard S.p.A.

Prodotto: CRURA SOFT PATCH

Il prodotto **CRURA SOFT PATCH** della Ditta Bard S.p.A. dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Documentazione tecnica:

Peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m²).

Con riferimento al "peso" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad esso dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire i relativi punteggi.

Porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %): < 1 micron. Punteggio 2

Spessore della rete: 0,66 mm. Punteggio 2

Varietà di misure: 2 misure. Punteggio 5

Covidien Italia S.p.A.

Prodotto: PARIETEX COMPOSITE

Il prodotto **PARIETEX COMPOSITE** della Ditta Covidien Italia S.p.A. dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Documentazione tecnica:

Peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m²).

Porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %).

Spessore della rete.

Con riferimento al "peso", alla "porosità" e allo "spessore della rete" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad essi dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire i relativi punteggi.

Varietà di misure: 1 misura. Punteggio 4

**LOTTO 14 – RETE BIOLOGICA DI MATRICE ACELLULARE DI DERMA PORCINO
CROSSLINKED:**

Sub A 10 x 15 cm (+/-2 cm), Sub B 15 x 20 cm (+/-5 cm), Sub C 20 x 30 cm (+/-5 cm).

Bard S.p.A.

Prodotto: COLLAMEND FM IMPLANT

Il prodotto **COLLAMEND FM IMPLANT** della Ditta Bard S.p.A. dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Documentazione tecnica:

Resistenza alla trazione.

Punto di rottura.

Elasticità (modulo di young).

Semplicità di preparazione all'utilizzo (tempi e modalità), residui di conservanti

Con riferimento alla "Resistenza alla trazione", al "Punto di rottura", alla "Elasticità (modulo di young)" e alla "Semplicità di preparazione all'utilizzo (tempi e modalità), residui di conservanti" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad essi dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire i relativi punteggi.

Disponibilità di misure e spessori diversi proposti a listino: 1 misura. Punteggio 2

Durata della sterilità (shelf life): 18 mesi. Punteggio 2

Covidien Italia S.p.A.

Prodotto: PERMACOL

Il prodotto **PERMACOL** della Ditta Covidien Italia S.p.A. dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Documentazione tecnica:

Resistenza alla trazione.

Punto di rottura.

Elasticità (modulo di young).

Semplicità di preparazione all'utilizzo (tempi e modalità), residui di conservanti

Durata della sterilità (shelf life).

Con riferimento alla "Resistenza alla trazione", al "Punto di rottura", alla "Elasticità (modulo di young)", alla "Semplicità di preparazione all'utilizzo (tempi e modalità), residui di conservanti" e alla "Durata della sterilità (shelf life)" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad essi dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire i relativi punteggi.

Disponibilità di misure e spessori diversi proposti a listino: numerose. Punteggio 7

**LOTTO 15 – RETE BIOLOGICA DI MATRICE ACELLULARE DI DERMA PORCINO
NON CROSSLINKED:**

Sub A 10 x 15 cm (+/-2 cm), Sub B 15 x 20 cm (+/-5 cm), Sub C 20 x 30 cm (+/-5 cm).

Distrex S.p.A.

Prodotto: STRATTICE

Il prodotto **STRATTICE** della Ditta Distrex S.p.A. dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Documentazione tecnica:

Resistenza alla trazione.

Punto di rottura.

Con riferimento alla “Resistenza alla trazione” e al “Punto di rottura” la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad essi dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire i relativi punteggi.

Elasticità (modulo di young): 56,8 +/-23,6 Mpa. Punteggio 4

Semplicità di preparazione all'utilizzo (tempi e modalità), residui di conservanti: fattibile, non indicati se presenti o meno residui di conservanti. Punteggio 3

Durata della sterilità (shelf life): 24 mesi. Punteggio 2

Disponibilità di misure e spessori diversi proposti a listino: 8 misure. Punteggio 7

Deco med S.r.l.

Prodotto: EGIS

Il prodotto **EGIS** della Ditta Deco med S.r.l. dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Documentazione tecnica:

Resistenza alla trazione: 16 Mpa. Punteggio 5

Punto di rottura: 130 N, resistenza allo strappo 50 N. Punteggio 3

Elasticità (modulo di young): 80 Mpa. Punteggio 4

Semplicità di preparazione all'utilizzo (tempi e modalità), residui di conservanti: fattibile, non presenti residui di conservanti. Punteggio 4

Durata della sterilità (shelf life): 5 anni. Punteggio 4

Disponibilità di misure e spessori diversi proposti a listino: 4 misure per open e 6 misure per chirurgia laparoscopica. Punteggio 7

LOTTO 16 – PERICARDIO ETEROLOGO NON CROSSLINKED:

Sub A 5 x 5 cm (+/-1 cm), Sub B 8 x 15 cm (+/-2 cm).

Baxter S.p.A.

Prodotto: VERITAS

Il prodotto **VERITAS** della Ditta Baxter S.p.A. dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Con riferimento alla misura richiesta per il sub lotto a) 8x15 cm (+/- 2 cm) la ditta presenta una misura da 4x 7 cm, fuori dal range previsto per un solo cm.

La commissione ritiene il prodotto conforme in quanto la misura di 7 cm tecnicamente non rappresenta un limite negativo e la differenza pari a 1 cm oltre il range di tolleranza fissato è ritenuto irrilevante e trascurabile.

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Documentazione tecnica:

Resistenza alla trazione.

Punto di rottura.

Elasticità (modulo di young).

Semplicità di preparazione all'utilizzo (tempi e modalità), residui di conservanti.

Con riferimento alla "Resistenza alla trazione", al "Punto di rottura", alla "Elasticità (modulo di young)" e alla "Semplicità di preparazione all'utilizzo (tempi e modalità), residui di conservanti" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad essi dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire i relativi punteggi.

Durata della sterilità (shelf life): 3 anni. Punteggio 4

Disponibilità di misure e spessori diversi proposti a listino: 8 misure. Punteggio 7

LOTTO 17 – DISPOSITIVO IN MATERIALE BIOLOGICO DI ORIGINE ANIMALE PER TRATTAMENTO DI FISTOLA:

Varie misure.

Covidien Italia S.p.A.

Prodotto: PERMACOL PASTE

Il prodotto *PERMACOL PASTE* della Ditta Covidien Italia S.p.A. dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Documentazione tecnica:

Integrazione tissutale.

Con riferimento alla "Integrazione tissutale" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad essi dedicata e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire i relativi punteggi.

Durata della sterilità (shelf life): 6 mesi. Punteggio 3

Varietà di misure e spessori: 1 sola soluzione da 3 cc offerta ma valutata positivamente la formulazione in pasta adattabile a varie esigenze, in quanto automodellante. Punteggio 8

Semplicità nell'applicazione: articolata e dettagliata, pronta all'uso. Punteggio 8

Deco med S.r.l.

Prodotto: PRESSFIT

Il prodotto *PRESSFIT* della Ditta Deco med S.r.l. dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Documentazione tecnica:

Integrazione tissutale.

Con riferimento alla "Integrazione tissutale" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad essi dedicata e,

pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire i relativi punteggi.

Durata della sterilità (shelf life): 5 anni. Punteggio 6

Varietà di misure e spessori: 2 misure. Punteggio 2

Semplicità nell'applicazione: articolata e dettagliata. Punteggio 4

LOTTO 18 – RETI PRESAGOMATE IN MATERIALE SINTETICO PER ERNIA PARASTOMALE:

Varie misure.

Bard S.p.A.

Prodotto: BARD CK PARASTOMAL PATCH

Il prodotto BARD CK PARASTOMAL PATCH della Ditta Bard S.p.A. dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Documentazione tecnica:

Peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m²).

Spessore della rete.

Con riferimento al “peso” e allo “spessore della rete” la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad essi dedicate e, pertanto dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire il relativo punteggio.

Porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %): piccoli pori variabili da 68x32 micron a 23x23 micron, grandi pori variabili da 781x765 a 1066x732 micron. Punteggio 5

Varietà di misure: 4 misure. Punteggio 4

Dipro Medical Devices S.r.l.

Prodotto: 2P PCMC

Relativamente al prodotto 2P PCMC della Ditta Dipro Medical Devices S.r.l. dalla disamina della documentazione tecnica presentata, non è chiaro se trattasi di rete presagomata o meno.

La Commissione decide, quindi, di aprire il campione, il quale risulta non conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara in quanto trattasi di rete non presagomata.

Herniamesh S.r.l.

Prodotto: RETE PER COLOSTOMIA

Il prodotto RETE PER COLOSTOMIA della Ditta Herniamesh S.r.l. dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Documentazione tecnica:

Peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m²): 177 g/m².
Punteggio 1.

Porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %): 644 micron dimensione pori, 73% porosità.
Punteggio 2

Spessore della rete: 0,7 mm +/- 10%. Punteggio 5

Varietà di misure: 1 misura. Punteggio 1

Distrex S.p.A.

Prodotto: DYNAMESH-IPST

Il prodotto DYNAMESH-IPST della Ditta Distrex S.p.A. dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Documentazione tecnica:

Peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m²): 108 g/m².
Punteggio 4

Porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %): dimensione pori > 1 mm (80% dei pori).
Punteggio 5

Spessore della rete: 0,7 mm. Punteggio 5

Varietà di misure: 4 misure. Punteggio 4

Covidien Italia S.p.A.

Prodotto: PARIETEX PARASTOMAL

Il prodotto PARIETEX PARASTOMAL della Ditta Covidien Italia S.p.A. dalla disamina della documentazione tecnica presentata, risulta conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

La Commissione prosegue, quindi, con la valutazione qualitativa e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Documentazione tecnica:

Peso (verrà dato un punteggio maggiore alla rete più leggera - valore espresso in g/m²).

Porosità (dimensione dei pori, porosità effettiva in %).

Spessore della rete.

Con riferimento al "peso", alla "porosità" e allo "Spessore della rete" la Commissione rileva che non è chiaro, all'interno della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, la parte ad essi dedicati e, pertanto, dispone di avanzare richiesta di precisazioni alla ditta stessa, al fine di attribuire i relativi punteggi.

Varietà di misure: 4 misure. Punteggio 4

Nell'impossibilità di concludere i lavori, alle ore 15.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 8.30 del giorno 14.11.2014 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire l'attività di valutazione.

Il Presidente della Commissione conserva le Buste 2 "Documentazione Tecnica" e la campionatura dei concorrenti in idoneo locale, chiuso a chiave e protetto, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Avv. Nicola De Conti

I COMPONENTI: Dott. Ferdinando Agresta


 Dott. Enrico Cian

 Dott.ssa Chiara Filippi

 Dott. Pierluigi Pilati

IL SEGRETARIO

VERBALIZZANTE Dott.ssa Lisa Brazzorotto

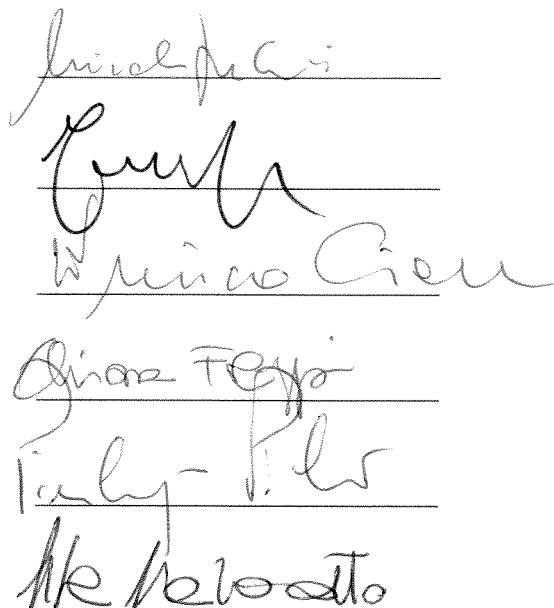

The block contains five handwritten signatures, each written on a horizontal line. From top to bottom, the signatures are: 1. A cursive signature that appears to be 'Nicola De Conti'. 2. A cursive signature that appears to be 'Ferdinando Agresta'. 3. A cursive signature that appears to be 'Enrico Cian'. 4. A cursive signature that appears to be 'Chiara Filippi'. 5. A cursive signature that appears to be 'Pierluigi Pilati'. Below these, there is a sixth signature that appears to be 'Lisa Brazzorotto', which is the secretary's signature.