

**PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE QUADRO PER LA
FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER I FABBISOGNI
DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO**

**VERBALE DEL 9/11/2015
QUARTA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 9 del mese di novembre dell'anno 2015, alle ore 9,30 presso il Magazzino Economale dell'AO di Padova, sito in Viale della Navigazione Interna, 38, Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la stipula di una convenzione quadro per la fornitura di materiale per anestesia e rianimazione, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 54 del 29/05/2015.

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 75 del 8/09/2015 così come modificata con Decreto n. 83 del 6/10/2015, risulta così composta:

Presidente: dott. Leonardo Götting - Anestesia e Rianimazione Az. Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Commissari:

- dott. Paolo Zanatta - Dirigente Medico del Servizio di Anestesia e Terapia Intensiva dell'Azienda Ulss n. 9 Treviso
- dott.ssa Roberta Foffano - Dirigente Farmacista del Servizio di Farmacia dell'Azienda Ulss n. 12 Veneziana
- dott.ssa Giovanna Pilotto - Dirigente Farmacista del Servizio di Farmacia dell'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino
- dott. Valter Favero - Coordinatore infermieristico della Cardiocirurgia T.I.P.O. A.O. Padova

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prosegue con la visione della campionatura presentata dalle Ditte per ogni singolo Lotto, al fine della verifica dei requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara e della valutazione della qualità dei prodotti offerti.

La Commissione, sulla scorta della valutazione della documentazione presentata e dei campioni forniti, formula i giudizi qualitativi riportati nelle tabelle allegate al presente Verbale relativamente ai lotti n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14.

La Commissione, sulla scorta della documentazione tecnica nonché della campionatura fornita, ritiene di dover escludere le ditte di seguito indicate per mancata conformità dei prodotti offerti ai requisiti minimi prescritti dal Capitolato di gara:

LOTTO 3

Ditta AMBU S.R.L.

Prodotto offerto: *Ambu AuraGain* Cod. prodotto: *408XXX000*

Motivo esclusione: Il prodotto offerto non presenta il sistema per agevolare il posizionamento in situ, caratteristica essenziale richiesta dal capitolato; la ditta viene esclusa dalla gara.

LOTTO 5

Ditta DEAS S.R.L.

Prodotto offerto: sub a) *DEAFLUX tubo tracheale non cuffiato senza occhio di murphy* Cod. prodotto: *ETANxxx01*; sub b) *DEAFLUX tubo tracheale non cuffiato con occhio di murphy* Cod. prodotto: *ETANxxx02*

Motivo esclusione: Il prodotto offerto per il lotto 5 sub a) non presenta la marcatura; la ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

Ditta SECURMED S.P.A.

Prodotto offerto: sub a) *Tubo enotracheale Securflow Vià Cod. Prodotto: da 11814101102 a 11814101106*; sub b) *Tubo enotracheale Securflow Vià Cod. Prodotto: da 11814101002 a 11814101006*

Motivo esclusione: Il prodotto offerto per il lotto 5 sub a) non presenta la marcatura. Per quanto riguarda il sub b) è presente piccolo segno di marcatura difficilmente riconoscibile e posto ad una distanza dalla punta inutilizzabile nei pazienti per cui è previsto l'uso. La ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

LOTTO 6

Ditta ALEA S.R.L. MEDICAL & DIAGNOSTICS SOLUTIONS

Prodotto offerto: *Tubo endotracheale oro/nasale cuffiato Cod. Prodotto: AL-MED-080xxA*

Motivo esclusione: il prodotto offerto non presenta la marcatura nella parte terminale del tubo. La ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

LOTTO 7

Ditta SECURMED S.P.A.

Prodotto offerto: *Tubo endotracheale Securflow Vià Cod prodotto: da 11814102103 a 11814102107*

Motivo esclusione: Assente la marcatura per la rilevazione della profondità dell'inserzione distale del tubo nelle misure 3 e 4: ove presente (misure 3,5, 4,5 e 5) è visibile solo su una piccola porzione del tubo e ad una distanza eccessiva. La ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

Ditta ALEA S.R.L. MEDICAL & DIAGNOSTICS SOLUTIONS

Prodotto offerto: *Tubo endotracheale oro/nasale cuffiato Cod. Prodotto: AL-MED-080xxA*

Motivo esclusione: Il prodotto presenta l'Occhio di murphy. Il capitolato tecnico richiede un dispositivo senza occhio di Murphy. La ditta viene esclusa dalla gara

Ditta WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.

Prodotto offerto: *Hi-contour cuffiato Cod. prodotto: 107-xxG*

Motivo esclusione: Il prodotto presenta l'Occhio di murphy. Il capitolato tecnico richiede un dispositivo senza occhio di Murphy. La ditta viene esclusa dalla gara

Ditta DEAS S.R.L.

Prodotto offerto: *DEAFLUX tubo tracheale non cuffiato senza occhio di murphy Cod. prodotto: ETANxxC01*

Motivo esclusione: il prodotto offerto non presenta la marcatura per la rilevazione della profondità dell'inserzione distale del tubo. La ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

LOTTO 8

Ditta SMITH MEDICAL ITALIA S.R.L.


Prodotto offerto: *Tubo endotracheale orale/nasale blue line cuffia profile soft-seal Cod. prodotto: 100/166/050, 100/166/055, 100/166/060, 100/166/065, 100/166/070, 100/166/075, 100/166/080, 100/166/085, 100/166/090, 100/166/095, 100/166/100*

Motivo esclusione: Il prodotto è senza l'Occhio di Murphy. Il capitolato tecnico richiede un dispositivo con occhio di Murphy. La ditta viene esclusa dalla gara

Ditta WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.

Prodotto offerto: *SATIN-SOFT HI-LO cuffiato Cod. prodotto: 409-XX*

Motivo esclusione: Il prodotto offerto non presenta la marcatura; la ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

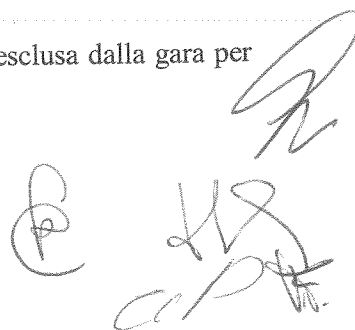

LOTTO 10

Ditta BENEFIS S.R.L.

Prodotto offerto: *REINFORCED TRACHEAL TUBE-CUFFED* Cod. prodotto: *55170xx1*

Motivo esclusione: Il prodotto è privo di marcatura per la rilevazione della profondità dell'inserzione distale del tubo; la ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

LOTTO 11

Ditta CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIP.

Prodotto offerto: *Mandrino monouso per intubazione* Cod. prodotto: *S1000NEU, S3000N, S5000N*

Motivo esclusione: Esclusa in quanto il tubo è in acciaio e non in alluminio malleabile come richiesto dal capitolato.

Ditta DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.

Prodotto offerto: *Pro-breathe intubation styles stiletti monouso* Cod. prodotto: *PBSxFR*

Motivo esclusione: Si rileva che il materiale del mandrino è PVC rinforzato internamente: viene esclusa perchè il dispositivo non è in alluminio malleabile come richiesto dal capitolato.

LOTTO 12

Ditta WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.

Prodotto offerto: *Sub a)Tubo preformato RAE nasale cuffiato* Cod. Prodotto: *119-xx Sub b)Tubo preformato RAE orale cuffiato*Cod. Prodotto: *115-xx*

Motivo esclusione: Il prodotto è privo di marcatura per la rilevazione della profondità dell'inserzione distale del tubo, sia nel sub a) sia nel sub b) richiesta dal capitolato di gara; la ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

Ditta TELEFLEX MEDICAL S.R.L.

Prodotto offerto: *Sub a) Safety Silk nasale, tubo ET preformato in PVC morbido* Cod. prodotto: *111782 Sub b) tubo tracheale preformato anatomicamente (AGT), in PVC siliconizzato RUSCHELIT* Cod. prodotto: *111780*Cod. Prodotto: *115-xx*

Motivo esclusione: Il prodotto è privo di marcatura per la rilevazione della profondità dell'inserzione distale del tubo nel sub lotto b), richiesta dal capitolato di gara; la ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

Ditta PHARMAGIC S.R.L.

Prodotto offerto: *Sub a) tubo endotracheale preformato nasale cuffiato misura da 6 a 8* Cod. prodotto: *37027xx10 Sub b) tubo endotracheale preformato orale cuffiato misura da 6 a 8* Cod. prodotto: *37025xx10*


Motivo esclusione: Il prodotto è privo di marcatura per la rilevazione della profondità dell'inserzione distale del tubo, richiesta dal capitolato di gara; la ditta viene esclusa dalla gara per assenza di una caratteristica essenziale richiesta dal capitolato tecnico.

Nell'impossibilità di terminare la valutazione della conformità dei prodotti offerti dalle ditte ai requisiti prescritti dal Capitolato Tecnico, nonché di concludere i lavori di valutazione qualitativa degli stessi, alle ore 17.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 9,00 del giorno 18/11/2015 presso il Magazzino Economale dell'AO di Padova, sito in Viale della Navigazione Interna, 38, Padova.

Il Presidente della Commissione conserva la campionatura presso la sede del Magazzino Economale della AO di Padova, situato in V.le Navigazione Interna n. 38 – Padova.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente:

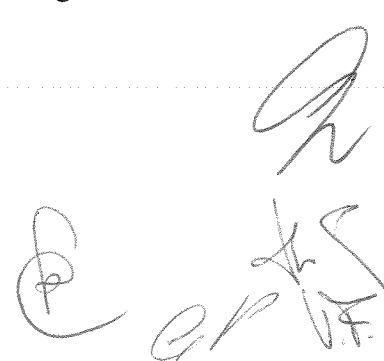

dott. Leonardo Götting

Componenti:

- dott. Paolo Zanatta

- dott.ssa Roberta Foffano

- dott.ssa Giovanna Pilotto

- dott. Valter Favero

Leonardo Götting
Paolo Zanatta
Roberta Foffano
Giovanna Pilotto
Valter Favero

Lotto 1 CANNULA DI GUEDEL

Cannula di Guedel monouso, realizzata in materiale plastico biocompatibile, con punta atraumatica, misure varie di lunghezza compresa da mm. 30 a mm.110 circa (n. 9 misure), con codice colore, in confezione singola, sterile.

Criteri di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Diametro del lume interno e sua compatibilità con sonde di aspirazione	10
Atraumaticità della punta	10
Maneggevolezza, ergonomia in funzione dell'utilizzazione e della praticità d'uso	15
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

BENEFIS S.r.l. Guedel Airway Cod. Prodotto: 90000301, 90000401, 90000501, 90000601, 90000701, 90000801, 90000901, 90001001, 90001101	PUNTI	SECURMED S.p.a. Cannula di Guedel Securflow Via Cod. prodotto: da 127141001004 a 127141001020	PUNTI	INTERSURGICAL S.p.A. Cannule Orofaringee di GUEDEL Cod. Prodotto: 11151205, 11141005, 11130905, 11120805, 11110655, 11115705, 11100555, 11000505, 10000355	PUNTI
Presenta gamma di misure come richiesto da capitolato e discreta compatibilità con le sonde di aspirazione	7	Il diametro interno nel punto più stretto (blocca morso) risulta di misure ridotte, discreta compatibilità con le sonde	6	Presenta gamma di misure come richiesto da capitolato e discreta compatibilità con le sonde di aspirazione	7
La punta risulta traumatica	5	La punta risulta atraumatica	10	La punta risulta atraumatica	10
Presenta codice colore limitato alla componente esterna del blocco morso della cannula. Questa componente risulta rimovibile e può quindi dislocarsi durante l'uso (in prossimità del cavo orale del paziente). Sul blocco morso è presente soltanto lunghezza della cannula che peraltro non risulta facilmente identificabile. La superficie convessa della cannula presenta una ridotta superficie di contatto con il retro faringe.	5	Presenta codice colore limitato alla componente esterna del blocco morso della cannula. Questa componente risulta rimovibile e può quindi dislocarsi durante l'uso (in prossimità del cavo orale del paziente). Sul blocco morso è presente soltanto lunghezza della cannula che peraltro non risulta facilmente identificabile.	6	Presenza di codice colore e codice numerico facilmente identificabili. In particolare per quanto riguarda il codice colore viene rappresentato dall'utilizzo di materiale di verso dal corpo della cannula ma perfettamente integrato e non rimuovibile. Buona maneggevolezza ed ergonomia. LA PRESENZA DI PUNTA DI COLORE DIVERSO DAL CORPO DELLA CANNULA LA RENDE FACILMENTE IDENTIFICABILE IN CASO DI PROCEDURE ENDOSCOPICHE	15
Confezionamento ed etichettatura adeguato.	5	L'apertura della confezione risulta poco pratica in quanto il punto di rottura dell'involucro non è facilmente identificabile, questo può creare allungamento dei tempi in caso di urgenza, l'etichetta è soltanto inserita nell'involucro senza essere applicata e quindi può essere persa dopo l'apertura, inoltre risulta poco leggibile e le dimensioni della cannula non sono riportate in maniera omogenea tra le diverse misure.	0	Confezionamento ed etichettatura adeguato.	5
	22		22		37

Non sono ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 24 punti, sui 40 punti massimi previsti

Handwritten signatures and initials: GP, HP, and a circular stamp.

Lotto 3 MASCHERA LARINGEA MONOUSO A DUE VIE CON CANALE PER ASPIRAZIONE GASTRICA

Maschera laringea monouso bilume disponibile nelle misure adulto, pediatrico, neonatale. La maschera deve avere le seguenti caratteristiche: - forma anatomica precurvata con tubo di drenaggio gastrico, coassiale al tubo di ventilazione, per permettere il posizionamento di sondini orogastrici di calibro adatto a garantire una adeguata aspirazione - punta rinforzata per prevenire il ripiegamento accidentale - bloccamorso incorporato - sistema di ritenzione dell'epiglottide nel lume della cuffia - sistema per agevolare il posizionamento in situ - cuffia gonfiabile per adattamento anatomico
--

Criteri di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Tipologia e conformazione della cuffia	10
Gamma delle misure	10
Praticità d'uso (modalità di introduzione, atraumaticità, posizionamento, tenuta, rigidità della punta, conformazione della parte distale):	15
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

TELEFLEX MEDICAL SRL LMA SUPREMETM Maschera Laringea Cod. prodotto: 1750XX	PUNTI
Cuffia adeguatamente conformata, con ottima adattabilità alle strutture anatomiche.	8
7 misure	8
Presenza di sistema di facilitazione di introduzione, curvatura del dispositivo ottimale per il posizionamento e il mantenimento in sede. Punta atraumatica con sbocco del canale per sondino orofaringeo. Canale per sondino totalmente incorporato nella struttura rigida del dispositivo.	10
Buono il confezionamento ed esaustiva l'etichetta	5
	31

Handwritten signatures and initials: *EP*, *MF*, *Am*, *Q*, *RF*.

Lotto 4 MASCHERA LARINGEA MONOUSO A DUE VIE CON STRUTTURA PREFORMATA AUTOMODELLANTE

Maschera laringea monouso bilume disponibile nelle misure adulto, pediatrico, neonatale. La maschera deve avere le seguenti caratteristiche: - forma anatomica precurvata con tubo di drenaggio gastrico (solo per le misure adulto e pediatrico), coassiale al tubo di ventilazione, per permettere il posizionamento di sondini orogastrici di calibro adatto a garantire una adeguata aspirazione - punta rinforzata per prevenire il ripiegamento accidentale - bloccamorso incorporato - sistema di ritenzione dell’epiglottide nel lume della cuffia - sistema per agevolare il posizionamento in situ - struttura preformata auto modellante
--

Criteri di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Tipologia e conformazione della cuffia	10
Gamma delle misure	10
Praticità d’uso (modalità di introduzione, atraumaticità, posizionamento, tenuta, rigidità della punta, conformazione della parte distale):	15
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

INTERSURGICAL S.p.A. I-GEL Cod. prod: 8201000, 8215000, 8202000, 8225000, 8203000, 8204000, 8205000	PUNTI
Cuffia in silicone automodellante con ottima adattabilità alle strutture anatomiche	8
7 misure	8
Buona conformazione per il posizionamento. Punta atraumatica.Presenza di canale per posizionamento di sondino orogastrico	13
Buono il confezionamento ed esaustiva l'etichetta	5
	34

249
G/P
V.F.
P

Lotto 5 TUBO ENDOTRACHEALE NON CUFFIATO PER INTUBAZIONE ORO- NASALE PER ANESTESIA

Tubo endotracheale non cuffiato per intubazione oro-nasale di breve durata in anestesia, realizzato in materiale plastico biocompatibile, punta atraumatica, linea radiopaca, diametro interno da mm 2.5 a mm 4.5, centimetratura e marcatura per la rilevazione della profondità dell'inserzione distale del tubo, in confezione singola, sterile.

Sub a) senza occhio di Murphy

Sub b) con occhio di Murphy

Criteri di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Atraumaticità della punta	10
Favorevole rapporto del diametro esterno/interno	10
Maneggevolezza nella manovra di inserimento e praticità d'uso	15
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

CLINI-LAB S.r.l. Sub a) Tubo endotracheale non cuffiati MAGILL Cod. prodotto: MM611400xx Sub b) Tubo endotracheale non cuffiati con occhio di murphy Cod. prodotto: MM611300xx	PUNTI	TELEFLEX MEDICAL SRL sub a)Safety Clear tubo in PVC siliconizzato RUSCHELIT, trasparente, senza cuffia, nasale/orale Cod. prodotto: 100380 sub b)Safety Clear tubo in PVC siliconizzato RUSCHELIT, trasparente, senza cuffia, nasale/orale Cod. prodotto: 100382	PUNTI
Punta smussa discretamente traumatica	4	Punta smussa molto traumatica	1
Discreto il rapporto	7	Buono il rapporto	8
Tubo morbido: tale caratteristica può rendere meno agevole il posizionamento.	13	Tubo con buona curvatura e ben direzionabile. Alla prova di passaggio con sondino di aspirazione si rileva costantemente un ostacolo alla progressione del sondino stesso nel tratto distale, pochi mm prima del foro di uscita, che risulta fortemente penalizzante vista la destinazione d'uso del dispositivo. Il raccordo al Mount è facilmente disinseribile dal tubo	7
Buono il confezionamento ed esaustiva l'etichetta	5	Buono il confezionamento ed esaustiva l'etichetta	5
	29		21

Non sono ammesse alla riparametrizzazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 24 punti, sui 40 punti massimi previsti

Am

4/2

HP


Lotto 6 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO PER INTUBAZIONE ORO-NASALE PER ANESTESIA ADULTI

Tubo endotracheale per intubazione oro-nasale di breve durata in anestesia, dotato di cuffia a bassa pressione, palloncino spia e valvola unidirezionale, realizzato in materiale plastico trasparente biocompatibile, punta atraumatica con occhio di Murphy, linea radiopaca, diametro interno da mm. 5 a mm. 9, centimetratura e marcatura per la rilevazione della profondità dell'inserzione distale del tubo, in confezione singola, sterile.

Criteri di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Atraumaticità della punta	5
Favorevole rapporto del diametro esterno/interno	5
Cuffia: conformazione, resistenza, favorevole rapporto volume/pressione	10
Maneggevolezza e praticità di utilizzo	15
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

CAREFUSION ITALY 311 S.r.l. Unip. Tubo endotracheale cuffiato Cod. prodotto: 80xxc	PUNTI	FERMED S.r.l. ENDOTRACHEAL TUBE Cod prodotto: 3102XXC	PUNTI	Securmed S.p.a. Tubo endotracheale Securflow Via Cod. prodotto: da 11814102007 a 11814102015	PUNTI	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. Hi-contour cuffiato Cod. prodotto: 107-xx	PUNTI	INTERSURGICAL S.p.A. IN-TUBE Cod. prodotto: 8040050, 8400055, 8040060, 8040065, 8040070, 8040075, 8040080, 8040085, 8040090	PUNTI
Punta traumatica	1	Punta traumatica	1	Punta traumatica	1	Punta atraumatica	5	Punta atraumatica	5
Rapporto adeguato	5	Rapporto adeguato	5	Rapporto adeguato	5	Rapporto adeguato	5	Rapporto adeguato	5
Cuffia con adeguato rapporto volume -pressione e resistenza. La struttura della cuffia fa sì che una volta sgonfiata risulti poco scorrevole fino ad apprezzare un netto scalino nei punti di inserzione sul tubo; tale caratteristica può ripercuotersi negativamente nella procedura di intubazione naso tracheale.	5	Cuffia con adeguato rapporto volume -pressione e resistenza. Tuttavia la cuffia presenta delle irregolarità in prossimità dell'attacco prossimale e distale sul tubo. Tale caratteristica potrebbe favorire il passaggio di secrezioni. Inoltre la struttura della cuffia fa sì che una volta sgonfiata risulti poco scorrevole nei punti di inserzione sul tubo; tale caratteristica può ripercuotersi negativamente nella procedura di intubazione naso tracheale.	3	Cuffia con adeguato rapporto volume -pressione e resistenza. La struttura della cuffia fa sì che una volta sgonfiata risulti poco scorrevole fino ad apprezzare un netto scalino nei punti di inserzione sul tubo; tale caratteristica può ripercuotersi negativamente nella procedura di intubazione naso tracheale.	5	Cuffia con adeguato rapporto volume -pressione e resistenza. Cuffia con ottima scorrevolezza.	10	Cuffia con adeguato rapporto volume -pressione e resistenza. Tuttavia la struttura della cuffia fa sì che una volta sgonfiata risulti poco scorrevole nei punti di inserzione sul tubo; tale caratteristica può ripercuotersi negativamente nella procedura di intubazione naso tracheale.	5
La marcatura è limitata ad una piccola porzione di tubo. Si apprezza una resistenza al passaggio del sondino o del mandrino.	5	La marcatura è limitata ad una piccola porzione di tubo e si presenta a 3cm dalla parte prossimale della cuffia. Si apprezza una resistenza al passaggio del sondino o del mandrino.	3	La marcatura è limitata ad una piccola porzione di tubo ed è poco evidente. Si presenta a 3cm dalla parte prossimale della cuffia. Si apprezza una resistenza al passaggio del sondino o del mandrino.	3	Ottima maneggevolezza. La centimetratura è riportata ogni 2 cm	13	Ottima maneggevolezza	15
Ottimo il confezionamento ed esaustiva l'etichetta	5	Confezionamento inadeguato rispetto alla misura del prodotto con rischio di apertura accidentale della confezione e perdita della sterilità. Etichettatura incompleta (assenza di indicazione latex free)	1	Apertura poco agevole ed etichetta incompleta (assenza di indicazione latex free)	2	Ottimo il confezionamento ed esaustiva l'etichetta	5	Ottimo il confezionamento ed esaustiva l'etichetta	5
	21		13		16		38		35

Non sono ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 24 punti, sui 40 punti massimi previsti

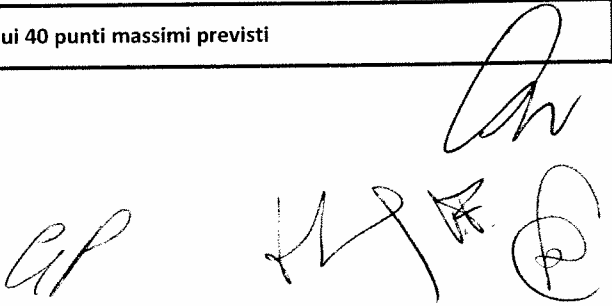

Lotto 7 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO PER INTUBAZIONE ORO-NASALE PER ANESTESIA PEDIATRICA

Tubo endotracheale per intubazione oro-nasale di breve durata in anestesia, dotato di cuffia a bassa pressione ed alto volume, palloncino spia e valvola unidirezionale, realizzato in materiale plastico trasparente biocompatibile, punta atraumatica senza occhio di Murphy, linea radiopaca, diametro interno da mm. 3 a mm. 5, centimetrazione e marcatura per la rilevazione della profondità dell'inserzione distale del tubo, in confezione singola, sterile.

Criteri di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Atraumaticità della punta	10
Favorevole rapporto del diametro esterno/interno	10
Cuffia: conformazione, resistenza, favorevole rapporto volume/pressione	10
Maneggevolezza e praticità di utilizzo	5
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

FERMED S.r.l. ENDOTRACHEAL TUBE Cod prodotto: 3108XXC	PUNTI	TELEFLEX MEDICAL SRL Super Safety Cleartubo tracheale in PVC siliconizzato RUSCHELIT Cod prodotto: 112480	PUNTI
Punta traumatica	2	Punta sufficientemente atraumatica	6
Rapporto adeguato	10	Rapporto adeguato	10
Cuffia di volume elevato per la destinazione d'uso. La cuffia presenta delle irregolarità in prossimità dell'attacco prossimale e distale sul tubo. Tale caratteristica potrebbe favorire il passaggio di secrezioni. Inoltre la struttura della cuffia (elevato volume) fa sì che risulti poco scorrevole. Tale caratteristica può ripercuotersi negativamente nella procedura di intubazione naso tracheale.	2	Cuffia cilindrica con buon rapporto volume pressione.	8
La marcatura è limitata ad una piccola porzione di tubo e si presenta ad una distanza eccessiva dalla cuffia. Il raccordo tra palloncino spia e tubo è di lunghezza eccessiva.	1	Maneggevolezza e praticità di utilizzo buone	4
Confezionamento adeguato. Etichettatura incompleta (assenza di indicazione latex free)	3	Confezionamento ed etichettatura complete	5
	18		33

Non sono ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 24 punti, sui 40 punti massimi previsti

Handwritten signatures and initials.

**Lotto 8 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO PER INTUBAZIONE ORO-
NASALE PER TERAPIA INTENSIVA ADULTI**

Tubo endotracheale per intubazione oro-nasale in terapia intensiva, dotato di cuffia a bassa pressione ed alto volume, palloncino spia con inserzione della via di gonfiaggio prossimale, valvola unidirezionale, realizzato in materiale plastico biocompatibile, punta atraumatica con occhio di Murphy, linea radiopaca, diametro interno da mm 5. a mm. 9, centimetratura e marcatura per la rilevazione della profondità dell'inserzione distale del tubo, in confezione singola, sterile.

Criteri di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Atraumaticità della punta	10
Favorevole rapporto del diametro esterno/interno	5
Cuffia: conformazione, resistenza, favorevole rapporto volume/pressione	10
Maneggevolezza nell'inserimento, praticità d'uso ed adattabilità in terapia intensiva	10
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

PHARMAGIC S.r.l. Tubo endotracheale cuffiato con occhio di Murphy in pvc siliconato a lunga permanenza Cod. prodotto: 37008xx95	PUNTI	Securmed S.p.a. Tubo endotracheale Securflow Via Cod. prodotto: da 11814102007 a 11814102015	PUNTI	TELEFLEX MEDICAL SRL Super Safety Silk tubo tracheale in PVC siliconato per intubazioni orali/nasali prolungate Cod prodotto: 112682	PUNTI	DEAS srl Deaflux tubo tracheale cuffiato con lume di aspirazione Cod. prodotto: ETSLXXC02	PUNTI
Punta traumatica	2	Punta traumatica	2	Punta atraumatica	10	Punta traumatica	2
Buono il rapporto del diametro esterno/interno	4	Buono il rapporto del diametro esterno/interno	4	Buono il rapporto del diametro esterno/interno	4	Buono il rapporto del diametro esterno/interno	4
buona conformazione resistenza rapporto volume-pressione	8	buona conformazione resistenza rapporto volume-pressione	8	buona conformazione resistenza rapporto volume-pressione	8	buona conformazione resistenza rapporto volume-pressione	8
La marcatura è limitata ad una piccola porzione di tubo e scarsamente visibile durante la manovra di intubazione. Il tubo di raccordo tra pallone spia e cuffia si inserisce distalmente potendosi trovare così al di sotto della rima orale. Il materiale di cui è costituito il tubo è rigido. Il raccordo tra tubo endotracheale e catheter mount si deconnette facilmente.	3	La marcatura è limitata ad una piccola porzione di tubo e scarsamente visibile durante la manovra di intubazione. La centimetratura è ogni 2cm. Il tubo di raccordo tra pallone spia e cuffia si inserisce distalmente potendosi trovare così al di sotto della rima orale. Il materiale di cui è costituito il tubo è rigido. Il raccordo tra tubo endotracheale e catheter mount si deconnette facilmente.	2	La marcatura è a tutta circonferenza e ben visibile. Il tubo di raccordo tra pallone spia e cuffia si inserisce prossimalmente risultando al di sopra della rima orale. Il materiale di cui è costituito il tubo è morbido. Il raccordo tra tubo endotracheale e catheter mount è di difficile deconnessione (termosaldato)	10	La marcatura è limitata ad una piccola porzione di tubo e scarsamente visibile durante la manovra di intubazione. Il tubo di raccordo tra pallone spia e cuffia si inserisce distalmente potendosi trovare così al di sotto della rima orale. Il materiale di cui è costituito il tubo è rigido. Il raccordo tra tubo endotracheale e catheter mount si deconnette facilmente. Il tubo presenta canale di aspirazione sopraglottica, non particolarmente ergonomico in caso di intubazione naso tracheale.	3
Confezionamento ed etichettatura buoni.	4	Etichettatura incompleta (assenza di indicazione latex free), apertura poco agevole.	2	Confezionamento ed etichettatura buoni.	4	Confezionamento ed etichettatura buoni.	4
	21		18		36		21

Non sono ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 24 punti, sui 40 punti massimi previsti

[Handwritten signatures and initials]

**Lotto 10 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO ARMATO PER
INTUBAZIONE ORO-NASALE PEDIATRICO**

Tubo endotracheale armato per intubazione oro-nasale, dotato di cuffia a bassa pressione ed alto volume, palloncino spia e valvola unidirezionale, realizzato in materiale plastico biocompatibile, punta atraumatica, misure varie da mm. 3.5 a mm. 5.5, centimetratura e marcatura per la rilevazione della profondità dell'inserzione distale del tubo, in confezione singola, sterile.

Criteri di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Atraumaticità della punta	5
Favorevole rapporto del diametro esterno/interno	5
Cuffia: conformazione, resistenza, favorevole rapporto volume/pressione	10
Maneggevolezza nell'inserimento, praticità d'uso	15
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

FERMED S.r.l. ENDOTRACHEAL TUBE Cod prodotto: 3101XXC	PUNTI	ALEA Srl Medical & Diagnostics Solutions Tubo endotracheale oro/nasale RINFORZATO CUFFIATO Cod. Prodotto: AL-MED-081xxA	PUNTI	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. Tubo armato Safety-flex cuffiato Cod. Prodotto: 118-xx	PUNTI	TELEFLEX MEDICAL SRL tubo endotracheale armato, in PVC, precurvato Cod prodotto: 104201	PUNTI	DEAS srl Deaflux tubo tracheale armato cuffiato Cod. Prodotto: ETA0xxC02A2	PUNTI
Punta discretamente atraumatica	4	Punta discretamente atraumatica	4	Punta atraumatica, estremamente morbida	5	Punta sufficientemente atraumatica	2	Punta discretamente atraumatica	4
Rapporto adeguato	5	Rapporto adeguato	5	Rapporto adeguato	5	rapporto tra diametro interno ed esterno poco favorevole in particolare nelle misure più piccole	2	Rapporto adeguato	5
Presenta una cuffia di forma cilindrica. Nelle misure inferiori il volume risulta eccessivo rispetto alle dimensioni del tubo rendendolo poco adeguato rispetto alla destinazione di impiego.	3	Presenta una cuffia di forma cilindrica. Nelle misure inferiori il volume risulta eccessivo rispetto alle dimensioni del tubo rendendolo poco adeguato rispetto alla destinazione di impiego.	3	conformazione della cuffia a goccia di bassa resistenza per i diametri maggiori con favorevole rapporto pressione/volume	10	cuffia di tipo cilindrico con favorevole rapporto pressione volume	9	La cuffia presenta una conformazione francamente asimmetrica su più campioni testati. Nelle misure inferiori si rileva una cuffia sovradimensionata rispetto alle misure del tubo	0
Presenta una marcatura poco evidente posizionata solo su un lato del tubo e a notevole distanza dall'attacco prossimale della cuffia	2	Presenta una marcatura limitata a una sola porzione della circonferenza e a notevole distanza dall'attacco prossimale della cuffia per le misure più piccole.	4	Presenta marcatura evidente su tutta la circonferenza del tubo ed una centimetratura con una scala di 2 cm. Presenta una marcatura con distanza adeguata dalla cuffia	13	Presenta marcatura evidente su tutta la circonferenza del tubo. Presenta una marcatura con distanza ottimale dalla cuffia.	15	La marcatura è presente solo su una piccola porzione del tubo. Presenta una marcatura con distanza adeguata dalla cuffia.	10
Etichettatura incompleta (assenza di indicazione latex free) e confezionamento di difficile apertura	2	Confezione di difficile apertura	3	Buona etichettatura e confezionamento	5	Buona etichettatura e confezionamento	5	Confezione di difficile apertura	3
	16		19		38		33		22

Non sono ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 24 punti, sui 40 punti massimi previsti

[Handwritten signatures and initials]

Lotto 11 MANDRINO MONOUSO PER TUBO TRACHEALE

Mandrino monouso per tubo tracheale standard, in alluminio malleabile con guaina protettiva, in confezione singola, sterile, misure varie (da neonatale ad adulti).

Criteri di valutazione	Punteggio Max attribuibile	BENEFIS S.r.l. Intubation Stylet Cod. prodotto: 550000x1	PUNTI	CLINI-LAB S.r.l. Mandrino per intubazione Unomedical Cod. prodotto: MM64000xx	PUNTI	Securmed S.p.a. Mandrino per intubazione Cod. prodotto: 127140112006 a 127140112014	PUNTI	ALEA Srl Medical & Diagnostics Solutions Mandrini per intubazione Cod. prodotto: AL-MED-079XXA	PUNTI	INTERSURGICAL S.p.A. Introduttori/sonde per tubi tracheali Cod. prodotto: 8080014, 8080010, 8080006	PUNTI	TELEFLEX MEDICAL SRL Flexi slip - mandrino singolo per intubazione Cod. prodotto: 503700	PUNTI	DEAS srl Deaflux mandrino per intubazione tracheale Cod. Prodotto: Mxxxx001	PUNTI
Malleabilità	10	Insufficiente: eccessivamente rigido nelle misure più grandi e troppo morbido nelle misure piccole	2	Sufficiente malleabilità	5	Discreta malleabilità	6	Discreta malleabilità	6	Buona malleabilità	8	Ottima malleabilità	10	Buona malleabilità	8
Mantenimento della conformazione data	10	Scadente soprattutto nella misura neonatale	2	Scadente soprattutto nella misura neonatale	2	Sufficiente nelle misure per adulti ed insufficiente per la misura neonatale	2	Sufficiente nelle misure per adulti ed insufficiente per la misura neonatale	2	Scadente soprattutto nella misura neonatale	2	Ottimo anche per le misure neonatali	10	Buono anche nelle misure neonatali	8
Gamma delle misure (particolare riferimento alle misure neonatale e pediatrica)	5	3 misure sia per lunghezze che per diametro	3	3 misure sia per lunghezze che per diametro	3	3 misure con lunghezze e diametri diversi	3	3 misure con lunghezze e diametri diversi	3	3 misure con tre diametri e tre lunghezze	3	4 misure con lunghezze e diametri diversi	5	3 misure con lunghezze e diametri diversi	3
Funzionalità e praticità di utilizzo	10	Discreta funzionalità	7	Discreta funzionalità	7	Discreta funzionalità	7	Discreta funzionalità	7	La punta del rivestimento si prolunga eccessivamente oltre l'anima in alluminio con possibilità di inginocchiamento e rottura con esposizione del metallo: tale caratteristica viene rilevata su tutte le misure offerte.	2	Ottima, facilmente adattabile a tubi di diversa lunghezza	10	Discreta funzionalità	7
Confezionamento ed etichettatura	5	Buona etichettatura e confezionamento	5	Buona etichettatura e confezionamento	5	Buono confezionamento : nell'etichetta le informazioni pur presenti risultavano poco visibili	3	Buona etichettatura e confezionamento: l'apertura della confezione primaria risulta scadente	3	Buona etichettatura e confezionamento: l'apertura della confezione primaria risulta discreta	4	Buona etichettatura e confezionamento	5	Buona etichettatura e confezionamento: l'apertura della confezione primaria risulta sufficiente	4
Totale punteggio qualità	40		19		22		21		21		19		40		30

Non sono ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 24 punti, sui 40 punti massimi previsti

gp
H
F
P

Lotto 12 TUBO ENDOTRACHEALE PREFORMATO CUFFIATO

Sub A) Per intubazione naso-tracheale
Tubo endotracheale per intubazione naso-tracheale preformato, dotato di cuffia a bassa pressione ed alto volume, palloncino spia e valvola unidirezionale, realizzato in materiale plastico biocompatibile, punta atraumatica, linea radiopaca longitudinale, diametro interno da mm. 6 a mm. 8, centimetrazione e marcatura per la rilevazione della profondità dell'inserzione distale del tubo, in confezione singola, sterile.

Sub B) Per intubazione oro-tracheale
Tubo endotracheale preformato per intubazione oro-tracheale (orientamento sud), dotato di cuffia a bassa pressione ed alto volume, palloncino spia e valvola unidirezionale, realizzato in materiale plastico biocompatibile, punta atraumatica, con occhio di murphy, linea radiopaca longitudinale, diametro interno da mm. 6 a mm. 8, centimetrazione e marcatura per la rilevazione della profondità dell'inserzione distale del tubo, in confezione singola, sterile.

Criteri di valutazione	Punteggio Max attribuibile	CLINI-LAB S.r.l. Sub a)Tubi endotracheali preformati nasali Unomedical Cod. prodotto: MM613130xx Sub b)Tubi endotracheali preformati orali Unomedical Cod. prodotto: MM612130xx	PUNTI	FERMED S.r.l. Sub a)Endotracheal Tube Cod. prodotto: 3104xxC Sub b)Endotracheal Tube Cod. prodotto: 3103xxC	PUNTI	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.r.l. Sub a) Pro-breathe - tubo endotracheale nasale preformato cuffiato Cod. prodotto: PB-2130x-NPF Sub b) Pro-breathe - tubo orale preformato cuffiato Cod. prodotto: PB-2120x-PF	PUNTI	Securmed S.p.a. SUB A) Tubo endotracheale Securflow Via Cod. prodotto: da 11814102259 a 11814102263 sub b) Tubo endotracheale Securflow Via Cod. prodotto: da 11814102209 a 11814102213	PUNTI	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A. Sub a) tubo endotracheale cuffiato preformato Sud Murphy Cod. prodotto: 0389720xx Sub b) tubo endotracheale cuffiato preformato Nord Murphy Cod. prodotto: 0389740xx	PUNTI	SMITH MEDICAL ITALIA SRL Sub a) Tubo endotracheale cuffiato preformato polar nasale nord Cod. prodotto: 100/133/0XX Sub B) Tubo endotracheale PREFORMATO POLAR ORALE SUD CUFFIA PROFILE SOFT-SEAL Cod. prodotto: 100/136/0XX	PUNTI	DEAS srl Sub a) Deaflux TUBO TRACH/NAS. PREFORMATO CUFFIATO Cod. Prodotto: ETPNxxC02 Sub b) Deaflux TUBO TRACH/ORAL PREFORMATO CUFFIATO Cod. Prodotto: ETPOxxC02	PUNTI
Atraumaticità della punta	5	Punta sufficientemente atraumatica	3	Punta traumatica	1	Punta traumatica	1	Punta traumatica	1	Punta sufficientemente atraumatica	3	Punta atraumatica	5	Punta traumatica	1
Favorevole rapporto del diametro esterno/interno	5	Adeguate rapporto i/o	5	Adeguate rapporto i/o	5	Adeguate rapporto i/o	5	Adeguate rapporto i/o	5	Adeguate rapporto i/o	5	Adeguate rapporto i/o	5	Adeguate rapporto i/o	5
Cuffia: conformazione, resistenza, favorevole rapporto volume/pressione	10	Sufficiente conformazione e resistenza	6	Sufficiente conformazione e resistenza	6	Sufficiente conformazione e resistenza	6	Sufficiente conformazione e resistenza	6	Sufficiente conformazione e resistenza	6	Buona conformazione e resistenza	8	Sufficiente conformazione e resistenza	6
Maneggevolezza nell'inserimento, praticità d'uso	15	La conformazione dei tubi offerti in entrambi i sublotti risulta sufficientemente adeguata. Il materiale risulta sufficientemente morbido.	7	La conformazione dei tubi offerti in entrambi i sublotti risulta poco adeguata. Il materiale è rigido	3	Il tubo preformato nasale presenta tubo di raccordo tra palloncino spia e cuffia inserito molto prossimalmente. Il materiale è rigido.	5	La conformazione dei tubi offerti in entrambi i sublotti risulta poco adeguata. Il materiale è rigido	3	La conformazione dei tubi offerti in entrambi i sublotti risulta sufficientemente adeguata. Il materiale risulta morbido.	9	Ottima conformazione, materiale particolarmente morbido ed adattabile	15	La conformazione dei tubi offerti in entrambi i sublotti risulta sufficientemente adeguata. Il materiale è rigido	5
Confezionamento ed etichettatura	5	Discreto confezionamento ed etichettatura	4	Sufficiente confezionamento, scarse le informazioni sull'etichetta	2	Sufficiente confezionamento ed etichettatura	3	Sufficiente confezionamento ed etichettatura	3	Discreto confezionamento ed etichettatura	4	Buono confezionamento ed etichettatura	5	Discreto confezionamento ed etichettatura	4
Totale punteggio qualità	40		25		17		20		18		27		38		21

Non sono ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 24 punti, sui 40 punti massimi previsti

CP

Handwritten signatures and initials.

Lotto 13 CATETERE SCAMBIATUBO

Catetere per sostituzione di tubo tracheale completo di via accessoria per ventilazione, centimetratura esterna, raccordo per sistema di ventilazione, misure varie (pediatrico e adulti), in confezione singola, sterile.

Criteri di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Atraumaticità della punta	5
Rapporto tra il diametro del lume per ventilazione e il diametro totale del catetere	10
Funzionalità e praticità di utilizzo	20
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

TELEFLEX MEDICAL SRL ENDOGUIDE T, SCAMBIATUBI Cod. prodotto: 503100	PUNTI	DEAS srl Deaflux GUIDA INTUBAZIONE TRACHEALE Cod. Prodotto: IGXX70011	PUNTI	COOK ITALIA Srl Catetere Cook airway exchange con adattatore multiraccord o rapi-fit Cod. prodotto: C-CAE-xxxxx	PUNTI
Punta sufficientemente atraumatica	2	Punta moderatamente atraumatica	3	Punta atraumatica	5
Adeguate il rapporto	10	Adeguate il rapporto	10	Adeguate il rapporto	10
Materiale rigido, presenza di un unico foro distale centrale per ossigenazione. Presenza di sole due misure. Il raccordo per la ventilazione si disconnette con facilità	5	Materiale rigido. Presenza di due fori distali laterali per ossigenazione. Presenza di tre misure. Presenta solo una marcatura ad intervalli di dieci centimetri. L'utilizzo del connettore per ossigenoterapia/ventilazione risulta poco intuibile e potrebbe generare ritardi nelle procedure	5	Presenta materiale morbido. Presenta tre fori (uno distale e due laterali) per ossigenazione. Presenza di tre misure. Presenta due raccordi per ventilazione e ossigenazione con sistema di fissaggio sicuro.	20
Buono confezionamento ed etichettatura	4	Buono confezionamento ed etichettatura	4	Ottimo il confezionamento ed etichettatura: ogni raccordo è confezionato singolarmente	5
	21		22		40

Non sono ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 24 punti, sui 40 punti massimi previsti

CP
H
VF
E

Lotto 14 TUBO ENDOBRONCHIALE DOPPIO LUME DESTRO "SENZA UNCINO/ROSTRO"

Set per intubazione bronchiale per chirurgia toracica, in materiale plastico biocompatibile, costituito da tubo a doppio lume endobronchiale destro, curvatura preformata, provvisto di cuffie bronchiale e tracheale a bassa pressione, con differenziazione cromatica delle cuffie e dei palloncini spia, linea radiopaca, punta atraumatica, completo di raccordi e sistemi di aspirazione, diametri da CH 35 a CH 41, centimetratura e marcatura per la rilevazione della profondità dell'inserzione distale del tubo, in confezione singola, sterile.

Criteri di valutazione	Punteggio Max attribuibile
Completezza degli accessori inseriti nella confezione	5
Conformazione e adattabilità della cuffia a garantire la pervietà bronchiale	5
Favorevole rapporto del diametro esterno del tubo/interno dei lumi	10
Maneggevolezza nell'inserimento e praticità d'uso	15
Confezionamento ed etichettatura	5
Totale punteggio qualità	40

PHARMAGIC S.r.l. set per intubazione bronchiale destra doppio lume composizione del set come da scheda tecnica Cod. prodotto: 37022xx20	PUNTI	SMITH MEDICAL ITALIA SRL Tubo endobronchiale a doppio lume bronco destro Cod. prodotto: 197-xxR	PUNTI	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.r.l. Broncho-cath destro con cuffia tracheale in poliuretano Cod. prodotto: 1260xx	PUNTI	TELEFLEX MEDICAL SRL BRONCHOPART - set per l'intubazione bronchiale destra Cod. prodotto: 116200	PUNTI	DEAS srl Deaflux TUBO BRONCHIALE BILUME DX Cod. Prodotto: BT11xx020	PUNTI
La confezione viene fornita con sondini di aspirazione con valvola di aspirazione controllata in confezione sterile.	5	La confezione viene fornita con sondini di aspirazione con valvola di aspirazione controllata in confezione sterile. I sondini di aspirazione sono dotati di valvola che non garantisce l'assenza di contaminazione dell'operatore.	4	La confezione viene fornita con sondini di aspirazione con valvola di aspirazione controllata	5	La confezione viene fornita con sondini di aspirazione con valvola di aspirazione controllata. I sondini di aspirazione sono dotati di valvola che non garantisce l'assenza di contaminazione dell'operatore.	4	La confezione viene fornita con sondini di aspirazione con valvola di aspirazione controllata in confezione sterile. I sondini di aspirazione sono dotati di valvola che non garantisce l'assenza di contaminazione dell'operatore.	4
Conformazione della cuffia è sufficientemente adeguata per l'uso previsto	3	La cuffia è di dimensioni cospicue e può facilmente erniare	2	Presenta cuffia sagomata che consente un'ottima tenuta sul bronco principale destro preservando dal rischio di esclusione del bronco lobare superiore da parte della cuffia stessa.	5	La cuffia ha una forma e un rapporto con il foro di ventilazione per il bronco lobare superiore che non garantisce l'ottimale ventilazione di quest'ultimo.	2	Cuffia con relativa sagomatura posta ad una distanza ritenuta non adeguata dal foro di ventilazione del bronco lobare superiore.	1
Buon rapporto	8	Buon rapporto	8	Buon rapporto	8	Buon rapporto	8	Buon rapporto	8
Il tubo viene fornito con mandrino di lunghezza tale da poter uscire dal foro di ventilazione del bronco lobare superiore, con potenziale rischio di lesione tracheale. Non sono presenti marcature atte a facilitare le manovre di inserzione. Il sistema di connessione compresi i tappi per l'inserzione di sondini per aspirazione o broncoscopi è di dimensioni cospicue e scarsamente ergonomico. Materiale di facile inginocchiamento.	1	Il tubo viene fornito con mandrino di adeguata lunghezza tuttavia di rigidità insufficiente a garantire la buona direzionabilità del tubo. Non sono presenti marcature atte a facilitare le manovre di inserzione. Il sistema di connessione una volta montato risulta rimovibile con difficoltà e presenta una facilità di inginocchiamento.	2	Il tubo viene fornito di mandrino di caratteristiche ottimali per facilitare l'inserzione. La punta del lume bronchiale è sagomata per consentire un'ottima atraumaticità. Distalmente sul lume tracheale è presente marcatura posta a facilitare le manovre di inserzione. Il sistema di connessione del tubo bilume al circuito di ventilazione è di dimensioni contenute e presenta tappi per inserzione di sondini per aspirazione o broncoscopi di buona qualità e tenuta. Il materiale presenta una buona resistenza al kinking	15	Il tubo viene fornito con mandrino di lunghezza eccessiva e tale da poter uscire dal foro di ventilazione del bronco lobare superiore, con potenziale rischio di lesione tracheale. Non sono presenti marcature atte a facilitare le manovre di inserzione. Il sistema di connessione è di dimensioni cospicue con tappi di inserzione di sondini per aspirazione o broncoscopi, ma presenta materiale di facile inginocchiamento. Il materiale costituente il tubo è rigido.	1	Il tubo viene fornito con mandrino di lunghezza tale da poter uscire dal foro di ventilazione del bronco lobare superiore, con potenziale rischio di lesione tracheale. Non sono presenti marcature atte a facilitare le manovre di inserzione. Il sistema di connessione è di dimensioni contenute con tappi di inserzione di sondini per aspirazione o broncoscopi, ma presenta materiale di facile inginocchiamento. Il materiale costituente il tubo è rigido.	1
Adeguate il confezionamento ed etichettatura: ogni elemento è confezionato singolarmente	4	Adeguate il confezionamento ed etichettatura: ogni elemento è confezionato singolarmente	4	Ottimo il confezionamento ed etichettatura: ogni elemento è confezionato singolarmente	5	Sufficiente il confezionamento: il sistema di connessione e i sondini di broncoaspirazione vengono forniti in involucro contenuto all'interno della confezione del tubo bilume	3	Sufficiente il confezionamento: il sistema di connessione viene fornito in involucro contenuto all'interno della confezione del tubo bilume	3
	21		20		38		18		17

Non sono ammesse alla riparametrazione del punteggio qualitativo né alla fase di valutazione delle offerte economiche le offerte delle Ditte che hanno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a complessivi 24 punti, sui 40 punti massimi previsti

[Handwritten signatures and initials]