

**GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PRESIDI PER PRELIEVI BIOLOGICI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO.**

**VERBALE DEL 08/10/2013  
PRIMA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 08 del mese di ottobre dell'anno 2013, alle ore 9,30 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto per la fornitura triennale di presidi per prelievi biologici in fabbisogno alle aziende sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 47 del 08/10/2013, così composta:

- |  |  |
|--|--|
| - Presidente: Dott.ssa Alberta Alghisi | Direttore U.O.C. Immunoematologia, Trasfusione e Genetica Umana dell'Azienda Ulss 6 di Vicenza,  |
| - Componente: Dott. Gianluca Gessoni   | Dirigente Medico Responsabile Servizio Medicina di laboratorio dell'Azienda Ulss 14 di Chioggia, |
| - Componente: Sig.ra Graziella Saccani | Coordinatrice Tecnico Sanitario di Laboratorio dell'ULSS 22 di Bussolengo                        |
| - Componente: Dott. Roberto Rigoli     | Dirigente Medico Responsabile del Dipartimento Patologia Clinica dell'ULSS n. 9 di Treviso,      |
| - Componente: Dott. Lucio Bacelle      | Dirigente Medico Responsabile del Dipartimento Servizi dell'ULSS n. 15 Alta Padovana             |

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lidia Pascucci, Collaboratore Amministrativo del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

La Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prosegue quindi, all'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Ditte ammesse, al fine di esprimere, una valutazione tecnico-qualitativa, sulla base della documentazione tecnica e della campionatura pervenuta dalle Ditte concorrenti, secondo i criteri di attribuzione dei punteggi e relativi pesi sono riportati nell'*Allegato 5* al Disciplinare.



**LOTTO 1 A - Aghi retti preassemblati (Calibro 21 G)**

La Presidente, dopo aver dato lettura del capitolato tecnico , apre lo scatolone contenente i campioni delle Ditte Offerenti

La Commissione, in seguito all'esame delle schede tecniche e dei campioni, **dichiara che i prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche richieste dal capitolato ed attribuisce i seguenti punteggi:**

**Ditta Becton Dickinson S.p.A:**

<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTI</b>	
<b>1 Funzionalità e maneggevolezza d'uso</b>	<b>7</b>	
Buona funzionalità e maneggevolezza. Le sfaccettature che rendono ergonomico il prodotto non sono peraltro presenti su tutta la superficie; il dispositivo di protezione non è ruotabile; la lunghezza della camicia è ottima.		
<b>2 Facilità d'uso dei dispositivi di sicurezza</b>	<b>8</b>	
Il dispositivo di sicurezza è articolato con una cerniera ad incastro rispetto all'ago e quindi si può staccare. E' presente un solo blocco per l'ago.		
<b>3 Proposta formativa per il personale addetto</b>	<b>3</b>	proposta formativa esauriente
<b>4 Facilità di penetrazione dell'ago</b>	<b>7</b>	ottima
<b>5 Lunghezza dell'ago</b>	<b>1</b>	lunghezza 1 pollice e un quarto
<b>6 Ermeticità della guaina dell'ago di campionamento in corso di prelievi multipli</b>	<b>7</b>	ottima ermeticità

**PUNTI COMPLESSIVI: 33**

**Ditta Pro.Lab**

<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTI</b>	
<b>1 Funzionalità e maneggevolezza d'uso</b>	<b>5</b>	
Discreta funzionalità e maneggevolezza. Le sfaccettature che rendono ergonomico il prodotto non sono presenti su tutta la superficie e la camicia ha lunghezza sufficiente.		
<b>2 Facilità d'uso dei dispositivi di sicurezza</b>	<b>6</b>	
L'articolazione del dispositivo di protezione, non ruotabile, è costituita da una piegatura nel materiale plastico. E' presente un solo blocco dell'ago quando attivato il dispositivo di sicurezza stesso.		
<b>3 Proposta formativa per il personale addetto</b>	<b>3</b>	proposta formativa esauriente
<b>4 Facilità di penetrazione dell'ago</b>	<b>5</b>	buona

2



5	Lunghezza dell'ago	3	lunghezza 1 pollice e un mezzo
6	Ermeticità della guaina dell'ago di campionamento in corso di prelievi multipli	7	ottima ermeticità

**PUNTI COMPLESSIVI: 29**

**Ditta Vacutest Kima**

CRITERIO	PUNTI
<b>1 Funzionalità e maneggevolezza d'uso</b>	<b>10</b>
Ottima Funzionalità e maneggevolezza. La lunghezza e conformazione della camicia con sfaccettature distribuite su tutta la superficie facilitano l'impugnatura. La possibilità di ruotare il dispositivo di protezione rende agevole l'utilizzo anche per gli operatori mancini.	
<b>2 Facilità d'uso dei dispositivi di sicurezza</b>	<b>10</b>
Il dispositivo è articolato rispetto all'ago con cerniera con perno inserito. Presente un doppio blocco dell'ago quando attivato il dispositivo di sicurezza stesso.	
<b>3 Proposta formativa per il personale addetto</b>	<b>3</b>
proposta formativa esauriente	
<b>4 Facilità di penetrazione dell'ago</b>	<b>7</b>
ottima	
<b>5 Lunghezza dell'ago</b>	<b>3</b>
lunghezza 1 pollice e un mezzo	
<b>6 Ermeticità della guaina dell'ago di campionamento in corso di prelievi multipli</b>	<b>7</b>
ottima ermeticità	

**PUNTI COMPLESSIVI: 40**

**LOTTO 1 B- C:**

*Camicie porta aghi monouso e Connettori sterili luer monouso*

La Presidente, dopo aver dato lettura del capitolato tecnico, apre lo scatolone contenente i campioni delle Ditte Offerenti

La Commissione, in seguito all'esame delle schede tecniche e dei campioni, **dichiara che i prodotti offerti dalla ditta Vacutest Kima sono conformi alle caratteristiche richieste dal capitolato per entrambi i sub lotti ed attribuisce i seguenti punteggi, per entrambi i sublotti.**

CRITERIO	PUNTI	
1 Ermeticità della guaina dell'ago di campionamento in corso di prelievi multipli	20	Ottima ermeticità
2 Ergonomicità della camicia di campionamento Ottima lunghezza della camicia e sfaccettature su tutta la superficie	10	
3 Facilità di assemblaggio e stabilità del sistema luer/camicia	5	Ottima
4 Tenuta della connessione del cono luer con i dispositivi compatibili	5	Ottima

**PUNTI COMPLESSIVI: 40**

Successivamente, la Commissione osserva quanto segue.

Per il sublotto 1-b le Ditte Becton Dickinson e Pro.Lab non presentano l'indicazione della data di scadenza. Peraltro, stante la destinazione d'uso, la non sterilità del dispositivo ed il fatto che sul capitolato ciò è richiesto nelle caratteristiche minime, e non in quelle esplicitamente a pena di esclusione, la Commissione ritiene di ammettere alla valutazione i campioni presentati dalle ditte Pro.Lab e Becton Dickinson, anche in ossequio al principio del *favor participationis*.

Alle ditte Pro.Lab e Becton Dickinson, quindi, vengono attribuiti i seguenti punteggi per entrambi i sublotti.

#### Ditta Pro.Lab

CRITERIO	PUNTI	
1 Ermeticità della guaina dell'ago di campionamento in corso di prelievi multipli	20	Ottima ermeticità
2 Ergonomicità della camicia di campionamento Lunghezza della camicia sufficiente e sfaccettature non distribuite su tutta la superficie	8	
3 Facilità di assemblaggio e stabilità del sistema luer/camicia	5	Ottima
4 Tenuta della connessione del cono luer con i dispositivi compatibili	5	Ottima

**PUNTI COMPLESSIVI: 38**

#### Ditta Becton Dickinson

CRITERIO	PUNTI	
1 Ermeticità della guaina dell'ago di campionamento in corso di prelievi multipli	20	Ottima ermeticità

4

2	<b>Ergonomia della camicia di campionamento</b>	10	
	Ottima lunghezza della camicia e sfaccettature su tutta la superficie		
3	<b>Facilità di assemblaggio e stabilità del sistema luer/camicia</b>	5	Ottima
4	<b>Tenuta della connessione del cono luer con i dispositivi compatibili</b>	5	Ottima
<b>PUNTI COMPLESSIVI: 40</b>			

LOTTO 1 D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q

Provette sottovuoto per raccolta ematica per analisi di laboratorio

La Presidente, dopo aver dato lettura del capitolato tecnico, apre gli scatoloni contenenti i campioni delle Ditte Offerenti

La Commissione, in seguito all'esame delle schede tecniche e dei campioni, **dichiara che i prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche richieste dal capitolato per tutti i sub lotti ed attribuisce i seguenti punteggi, per i sublotti in esame**

Circa il primo criterio "Qualità del sistema separatore gel/siero/plasma", la Commissione stabilisce di svolgere prove pratiche presso le Aziende di afferenza dei Commissari.

A tal fine, i Dottori Alghisi e Gessoni trattengono 10 provette a testa tra i campioni che ciascuna Ditta ha presentato per i sublotti 1e ed 1g e procedono ad una valutazione della potassiemia in serie di 10 tubi senza separatore e 10 tubi con separatore per ciascuna ditta

Inoltre, il dottor Bacelle trattiene 10 provette tra i campioni che ciascuna Ditta ha presentato per il sublotto 1i (eparina di litio) su cui procede ad una valutazione di al ALT, Fosfatasi alcalina, creatinina, LDH, sodio, potassio, cloro, glucosio, FT4, ferritina.

Per i rimanenti criteri, si esprimono i punteggi seguenti:

**Ditta Becton Dickinson**

CRITERIO	PUNTI		
2	<b>Evidenze bibliografiche su interferenza o meno degli additivi/anticoagulanti/componenti o materiali della provetta</b>	4	numerosità importante
3	<b>Chiarezza delle informazioni riportate su ogni singola provetta</b>	6	ottima
4	<b>Maneggevolezza e sicurezza per l'operatore</b>	8	Ottima
5			

**5 Confezionamento 7**

La Ditta menziona confezionamenti da 1000 provette

**Ditta Pro.Lab**

<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTI</b>	
<b>2 Evidenze bibliografiche su interferenza o meno degli additivi/anticoagulanti/componenti o materiali della provetta</b>	<b>1</b>	numerosità scarsa
<b>3 Chiarezza delle informazioni riportate su ogni singola provetta</b>	<b>6</b>	ottima
<b>4 Maneggevolezza e sicurezza per l'operatore</b>	<b>8</b>	Ottima
<b>5 Confezionamento</b>	<b>5</b>	


La Ditta menziona confezionamenti da 1200 provette

**Ditta Vacutest Kima**

<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTI</b>	
<b>2 Evidenze bibliografiche su interferenza o meno degli additivi/anticoagulanti/componenti o materiali della provetta</b>	<b>1</b>	numerosità scarsa
<b>3 Chiarezza delle informazioni riportate su ogni singola provetta</b>	<b>6</b>	ottima
<b>4 Maneggevolezza e sicurezza per l'operatore</b>	<b>8</b>	Ottima
<b>5 Confezionamento</b>	<b>10</b>	

La Ditta fa presente la possibilità di fornire, se richiesto, le provette in multipli di 100.

La seduta si conclude alle ore 14.30.

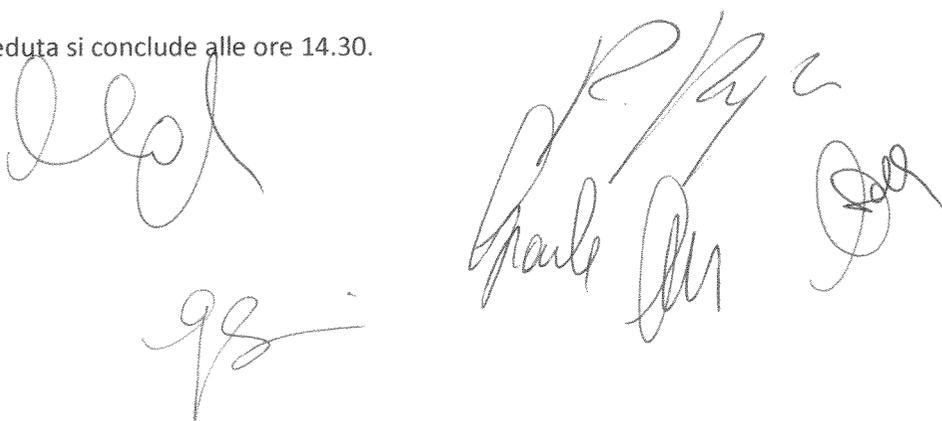

**GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PRESIDI PER PRELIEVI BIOLOGICI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO.**

**VERBALE DEL 28/10/2013  
SECONDA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 28 del mese di ottobre dell'anno 2013, alle ore 9,30 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto per la fornitura triennale di presidi per prelievi biologici in fabbisogno alle aziende sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto.


La Commissione, nominata con decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 47 del 08/10/2013, così composta:

- |  |  |
|--|--|
| - Presidente: Dott.ssa Alberta Alghisi | Direttore U.O.C. Immunoematologia, Trasfusione e Genetica Umana dell'Azienda Ulss 6 di Vicenza,  |
| - Componente: Dott. Gianluca Gessoni   | Dirigente Medico Responsabile Servizio Medicina di laboratorio dell'Azienda Ulss 14 di Chioggia, |
| - Componente: Sig.ra Graziella Saccani | Coordinatrice Tecnico Sanitario di Laboratorio dell'ULSS 22 di Bussolengo                        |
| - Componente: Dott. Roberto Rigoli     | Dirigente Medico Responsabile del Dipartimento Patologia Clinica dell'ULSS n. 9 di Treviso,      |
| - Componente: Dott. Lucio Bacelle      | Dirigente Medico Responsabile del Dipartimento Servizi dell'ULSS n. 15 Alta Padovana             |

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Lidia Pascucci, Collaboratore Amministrativo del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prosegue quindi, all'apertura e disamina dei campioni presentati dalle Ditte ammesse, al fine di esprimere, una valutazione tecnico-qualitativa, sulla base della documentazione tecnica e della campionatura pervenuta dalle Ditte concorrenti, secondo i criteri di attribuzione dei punteggi e relativi pesi sono riportati nell'*Allegato 5* al Disciplinare.

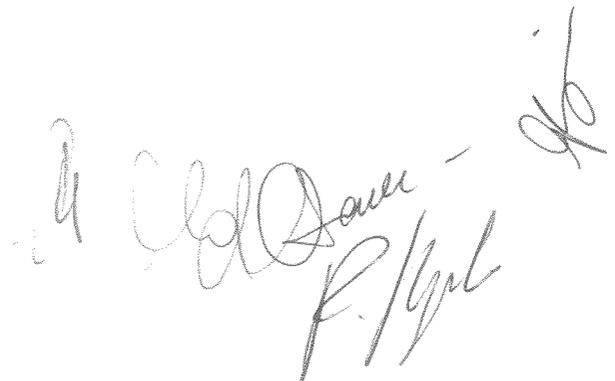

LOTTO 1 D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q

Provette sottovuoto per raccolta ematica per analisi di laboratori

Circa il primo criterio "Qualità del sistema separatore gel/siero/plasma", la Commissione valutati i risultati delle prove effettuate, valuta che i prodotti delle tre ditte sono equivalenti, si esprime, quindi , per tutte e tre le ditte il punteggio di 10 per il criterio "**Qualità del sistema separatore gel/siero/plasma**".

I punteggi assegnati sono pertanto:

**Ditta Becton Dickinson**

CRITERIO	PUNTI	
1 Qualità del sistema separatore gel/siero/plasma	10	ottima
2 Evidenze bibliografiche su interferenza o meno degli additivi/anticoagulanti/componenti o materiali della provetta	4	numerosità importante
3 Chiarezza delle informazioni riportate su ogni singola provetta	6	ottima
4 Maneggevolezza e sicurezza per l'operatore	8	Ottima
5 Confezionamento	7	

La Ditta menziona confezionamenti da 1000 provette

**PUNTI COMPLESSIVI: 35**

**Ditta Pro.Lab**

CRITERIO	PUNTI	
1 Qualità del sistema separatore gel/siero/plasma	10	ottima
2 Evidenze bibliografiche su interferenza o meno degli additivi/anticoagulanti/componenti o materiali della provetta	1	numerosità scarsa
3 Chiarezza delle informazioni riportate su ogni singola provetta	6	ottima
4 Maneggevolezza e sicurezza per l'operatore	8	Ottima

2

**5 Confezionamento** **5**

La Ditta menziona confezionamenti da 1200 provette

**PUNTI COMPLESSIVI: 30**

**Ditta Vacutest Kima**

<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTI</b>	
<b>1 Qualità del sistema separatore gel/siero/plasma</b>	<b>10</b>	ottima
<b>2 Evidenze bibliografiche su interferenza o meno degli additivi/anticoagulanti/componenti o materiali della provetta</b>	<b>1</b>	numerosità scarsa
<b>3 Chiarezza delle informazioni riportate su ogni singola provetta</b>	<b>6</b>	ottima
<b>4 Maneggevolezza e sicurezza per l'operatore</b>	<b>8</b>	Ottima
<b>5 Confezionamento</b>	<b>10</b>	

La Ditta fa presente la possibilità di fornire, se richiesto, le provette in multipli di 100.

**PUNTI COMPLESSIVI: 35**

#### **LOTTO 2 A – B – C:**

**Dispositivi per la raccolta e per il campionamento delle urine per analisi di laboratorio**

La Commissione, presa visione del capitolato, dei campioni e delle schede tecniche, stabilisce che tutti i prodotti offerti sono conformi ai requisiti stabiliti dal Capitolato e decide di valutare congiuntamente tutti e tre i sublotti.

Successivamente, la Commissione apre gli scatoloni contenenti i campioni ed esprime i seguenti punteggi.

**Ditta Pro.Lab**

<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTI</b>	
<b>1 Praticità e facilità d'uso</b>	<b>9</b>	ottima
<b>2 Qualità del materiale informativo fornito</b>	<b>8</b>	

Materiale illustrativo esaustivo direttamente sulla scatola del kit e in parte anche sul tappo del contenitore attraverso immagini

**3**

<b>3</b>	<b>Chiarezza delle informazioni riportate su ogni singola provetta</b>	<b>3</b>	Informazioni sufficienti
<b>4</b>	<b>Maneggevolezza e sicurezza per l'operatore/utente</b>	<b>11</b>	Ottima maneggevolezza. Quanto presentato dalla Ditta garantisce la sicurezza per l'operatore utente
<b>5</b>	<b>Packaging</b>	<b>6</b>	La Ditta presenta per il kit una scatola di cartone con riportate le istruzioni di prelievo, cosa che viene considerata in modo positivo. Tuttavia, all'interno, il contenitore e la provetta non sono ulteriormente protetti

**PUNTI COMPLESSIVI: 37**

**Ditta VACUTEST KIMA**

<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTI</b>	
<b>1</b> <b>Praticità e facilità d'uso</b>	<b>9</b>	ottima
<b>2</b> <b>Qualità del materiale informativo fornito</b> Materiale esaustivo e plurilingue in scheda allegata	<b>8</b>	
<b>3</b> <b>Chiarezza delle informazioni riportate su ogni singola provetta</b>	<b>3</b>	Informazioni sufficienti
<b>4</b> <b>Maneggevolezza e sicurezza per l'operatore/utente</b>	<b>11</b>	Ottima maneggevolezza. Quanto presentato dalla Ditta garantisce la sicurezza per l'operatore utente
<b>5</b> <b>Packaging</b>	<b>8</b>	confezionamento del kit ottimale

**PUNTI COMPLESSIVI: 39**

**Ditta LABOINDUSTRIA**

<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTI</b>	
<b>1</b> <b>Praticità e facilità d'uso</b> La ditta, relativamente ai contenitori per urine, presenta sul tappo una linguetta con uno scarso invito all'apertura	<b>6</b>	
<b>2</b> <b>Qualità del materiale informativo fornito</b>	<b>1</b>	Materiale insufficiente
<b>3</b> <b>Chiarezza delle informazioni riportate su ogni singola provetta</b>	<b>2</b>	La Ditta riporta informazioni sufficienti ma, sulla provetta non assemblata, non è presente l'indicazione del massimo volume di riempimento.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

**4 Maneggevolezza e sicurezza per l'operatore/utente 8**

La Ditta presenta per sublotto c) un confezionamento di apertura non agevole

**5 Packaging 3**


La Ditta ha un confezionamento scadente poiché costituito da un sacchetto di plastica termosaldato con etichetta stampata apposta

**PUNTI COMPLESSIVI: 20**

***La Ditta Laboindustria viene esclusa dalle fasi successive di gara per il lotto 2, poiché non ha raggiunto il punteggio minimo di 21/40.***

La Commissione stabilisce di riepilogare i punteggi attribuiti nel Prospetto allegato.

La riunione si conclude alle ore 15.00



Handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are three distinct signatures: the top one appears to be 'Dante', the middle one 'R. Pyl.', and the bottom one 'A. P.'. To the right of these, there are two more signatures: a larger one in the middle and a smaller one to its right.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI PUNTEGGI TECNICI \***  
 \* (da riparametrare ai sensi dell'articolo 6 del disciplinare di gara)

LOTTO 1a: Aghi retti preassemblati (Calibro 21 G)	Punti attribuibili	Becton Dickinson	Pro.Lab	Vacutest KIMA
Funzionalità e maneggevolezza d'uso	10	7	5	10
Facilità d'uso dei dispositivi di sicurezza	10	8	6	10
Proposta formativa per il personale addetto	3	3	3	3
Facilità di penetrazione dell'ago	7	7	5	7
Lunghezza dell'ago	3	1	3	3
Ermeticità della guaina dell'ago di campionamento in corso di prelievi multipli	7	7	7	7
<b>Totale punti:</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>40</b>

LOTTO 1 b-c: Camicie porta aghi monouso e Connettori sterili luer monouso	Punti attribuibili	Becton Dickinson	Pro.Lab	Vacutest KIMA
Ermeticità della guaina dell'ago di campionamento in corso di prelievi multipli	20	20	20	20
Ergonomia della camicia di campionamento	10	10	8	10
Facilità di assemblaggio e stabilità del sistema luer/camicia	5	5	5	5
Tenuta della connessione del cono luer con i dispositivi compatibili	5	5	5	5
<b>Totale punti:</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>40</b>

LOTTO 1 D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q: Provette sottovuoto per raccolta ematica per analisi di laboratorio	Punti attribuibili	Becton Dickinson	Pro.Lab	Vacutest KIMA
Qualità del sistema separatore gel/siero/plasma	12	10	10	10
Evidenze bibliografiche su interferenza o meno degli additivi/anticoagulanti/componenti o materiali della provetta	4	4	1	1
Chiarezza delle informazioni riportate su ogni singola provetta	6	6	6	6
Maneggevolezza e sicurezza per l'operatore	8	8	8	8
Confezionamento (punteggio migliore alla disponibilità di confezionamenti/ordini minimi)	10	7	5	10
<b>Totale punti:</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>35</b>

TOTALE PUNTI LOTTO 1	Becton Dickinson	Pro.Lab	Vacutest KIMA
Totale somma punti:	108	97	115

LOTTO 2 A - B - C: Dispositivi per la raccolta e per il campionamento delle urine per analisi di laboratorio	Punti attribuibili	Pro.Lab	Vacutest Kima	Labo Industria
Praticità e facilità d'uso	10	9	9	6
Qualità del materiale informativo fornito	8	8	8	1
Chiarezza delle informazioni riportate su ogni singola provetta	3	3	3	2
Maneggevolezza e sicurezza per l'operatore/utente	11	11	11	8
Packaging	8	6	8	3
<b>Totale punti:</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>20</b>

Esclusa per non aver raggiunto il punteggio minimo