

**GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA  
FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DEL  
VENETO**

---

**VERBALE DEL 04/02/2015  
PRIMA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 4 del mese di febbraio dell'anno 2015, alle ore 9,30 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio L. Gaudenzio 1 - Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di Aghi e siringhe per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto, per la durata di tre anni, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 73 del 06/11/2014.

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 10 del 23/01/2015, risulta così composta:

• Presidente:

- Dr.ssa Daniela Barzan: Dirigente farmacista presso la Ulss n. 13 di Mirano;

• Componenti:

- Sig.ra Paola Battanoli: Coordinatore Infermieristico presso il di Dipartimento Emergenza Urgenza - U.O. ISTAR 2 – AO di Padova;

- Sig.ra Bertilla Ranzato: Coordinatore Infermieristico presso il Dipartimento Salute della Donna e del Bambino - Coordinatore U.O. Chirurgia Pediatrica – AO di Padova;

- Sig. Franco Martinello: Coordinatore Infermieristico presso la U.O. Nefrologia e Dialisi-AO di Padova;


- Sig. Nicola Galtarossa: Coordinatore Infermieristico presso la SC Oncologia medica 2 – IRCCS IOV;

svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante la dott.ssa Roberta Padovan, in servizio presso la Sezione Controlli Governo e Personale della Regione del Veneto.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente comunica che, in esito alla prima seduta pubblica di gara, tenutasi il 15 gennaio 2015 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, i sotto indicati operatori economici sono stati ammessi al prosieguo della gara, a seguito del riscontro positivo della documentazione amministrativa presentata dai medesimi a corredo dell'offerta, come risulta dal verbale dell'Ufficiale Rogante (rep. n. 7245 – Racc. n. 6527) del quale viene data lettura:

- 1) RIMOS s.r.l. con sede in Mirandola (MO)
- 2) COOK ITALIA s.r.l. con sede in Nova Milanese (MB)
- 3) VERSAN & DAFNE M.D. s.r.l. con sede in Campagnola di Zevio (VR)
- 4) FERRARI L. DI FERRARI PIETRO s.r.l. con sede in Verona
- 5) FITOCHINA ITALIA s.r.l. con sede in Roma
- 6) VYGON ITALIA ITALIA s.r.l. con sede in Padova
- 7) CARE FUSION 311 s.r.l. unip. con sede in Sesto Fiorentino (FI)
- 8) CO.DI. SAN s.p.a. con sede in Belpasso (CT)

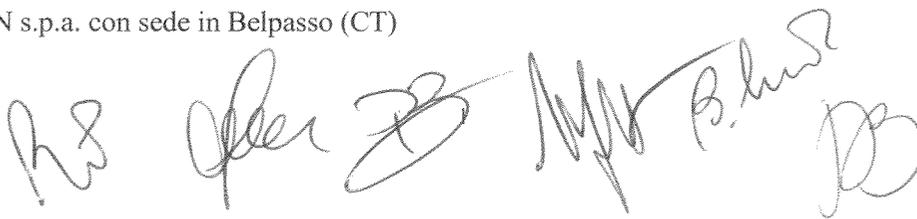

- 9) BTC MEDICAL EUROPE s.r.l. con sede in Valeggio sul Mincio (VR)
- 10) GAMBRO HOSPAL s.p.a. con sede in Bologna
- 11) GEPA s.r.l. con sede in Bollate (MI)
- 12) CODAN s.r.l. con sede in Mirandola (MO)
- 13) CAIR ITALIA s.r.l. con sede in Praglia di Teolo (PD)
- 14) HS HOSPITAL SERVICE s.p.a. con sede in Roma
- 15) SMITHS MEDICAL ITALIA s.r.l. con sede in Latina Scalo (LT)
- 16) BENEFIS s.r.l. con sede in Genova
- 17) COVIDIEN ITALIA s.p.a. con sede in Segrate (MI)
- 18) RAYS s.p.a. con sede in Osimo (AN)
- 19) FARMAC ZABBAN s.p.a. con sede in Calderara di Reno (BO)
- 20) NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT s.r.l. con sede in Castelvechio di Monte Porzio (PU)
- 21) PROMED s.r.l. con sede in Dosson di Casier (TV)
- 22) CLINI-LAB s.r.l. con sede in Conselve (PD)
- 23) CHEMIL s.r.l. con sede in Padova
- 24) ARTSANA s.p.a. con sede in Grandate (CO)
- 25) DBN Store di Tiziano Pellati con sede in Casalgrande (RE)
- 26) PRO.LAB s.r.l. con sede in Aiello del Friuli (UD)
- 27) MULTIMEDICAL S.r.l. con sede in Viadana (MN).

Il Presidente richiama i contenuti dell'articolo 7 del Disciplinare di gara, il quale prevede che l'aggiudicazione avvenga a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

La procedura di valutazione dell'offerta prevede, per ognuno dei LOTTI di gara, l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri: Offerta tecnica (max punti 40/100), Offerta economica (max punti 60/100).


La Commissione giudicatrice all'uopo nominata esprimerà una valutazione tecnico-qualitativa, sulla base della documentazione tecnica e della campionatura pervenuta dalle Ditte concorrenti. I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono riportati nell'Allegato 6 al Disciplinare di gara dal titolo "Criteri di valutazione aghi e siringhe".

Saranno escluse dalla gara le offerte che, sulla base della documentazione tecnica e dei campioni inviati dalle Ditte concorrenti, risulteranno non conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico; non verranno ammesse all'apertura delle offerte economiche, per ciascun singolo lotto, le ditte che totalizzeranno un punteggio di qualità inferiore a 24/40.

La Commissione prende atto, infine, che i LOTTI 4, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19 andranno deserti, in mancanza di offerte pervenute.

Il Presidente e gli altri membri della Commissione procedono, quindi, all'analisi congiunta della documentazione tecnica, contenuta nella busta n. 2, presentata dai concorrenti ammessi, LOTTO per LOTTO, al fine di verificarne la conformità alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

**LOTTO N. 1 - AGHI IPODERMICI PER INIEZIONE E PRELIEVO STERILI MONOUSO CONO LUER**

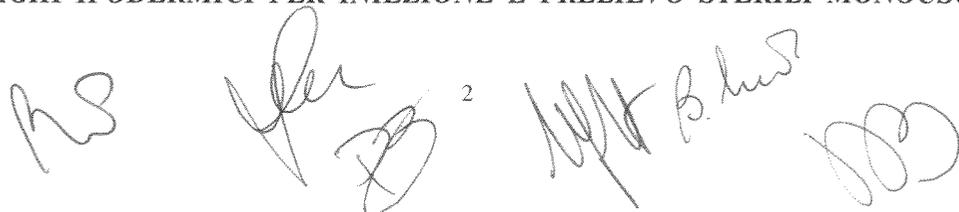

Handwritten signatures and initials of the commission members, including a small number '2' in the center.

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- RAYS – prodotto Microtip/Ultra
  - Mis 18GX1 ½ colore rosa REF HN18G38 RDM 501460
  - Mis 19GX1 ½ colore crema REF HN19G38 RDM 692147
  - Mis 20GX1 ½ colore giallo REF HN20G38 RDM 501462
  - Mis 21GX1 ½ colore verde REF HN21G38 RDM 501463
  - Mis 22GX1 ¼ colore nero REF HN22G32 RDM 501464
  - Mis 23Gx1 colore azzurro REF HN23G25 RDM 501467
  - Mis 23 GX1/4 colore azzurro REF HN65G30 RDM 502466
  - Mis 25GX5/8 colore arancione REF HN25G16 RDM 502471
  - Mis 25GX1 colore arancione REF HN25G25 RDM 668948
  - Mis 26Gx1/2 colore marrone REF HN26G13 RDM 501468

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

- PROMED – prodotto BD Microlance 3
  - Mis. 26GX5/8 (16mm) colore marrone REF BDI-304300 RDM 31654
  - Mis. 26GX1/2 (13mm) colore marrone REF BDI-303800 RDM 31654
  - Mis. 26GX3/8 (10mm) colore marrone REF BDI-300300 RDM 31654
  - Mis. 25GX1 (25mm) colore arancio REF BDI-300400 RDM 31654
  - Mis. 25GX5/8 (16mm) colore arancio REF BDI-300600 RDM 31654
  - Mis. 24GX1 (25mm) colore violetto REF BDI-304100 RDM 31654
  - Mis. 23GX1-1/4 (30mm) colore blu REF BDI-300700 RDM 31640
  - Mis. 23GX1 (25mm) colore blu REF BDI-300800 RDM 31640
  - Mis. 22GX1-1/2 (40mm) colore nero REF BDI-301000 RDM 31640
  - Mis. 22GX1-1/4 (30mm) colore nero REF BDI-300900 RDM 31640
  - Mis. 22GX1 (25mm) colore nero REF BDI-304727 RDM 31640
  - Mis. 21GX1-1/2 (40mm) colore verde REF BDI-304432 RDM 31640
  - Mis. 21GX1 (25mm) colore verde REF BDI-301156 RDM 31640
  - Mis. 20GX1-1/2 (40mm) colore giallo REF BDI-301300 RDM 31640
  - Mis. 20GX1 (25mm) colore giallo REF BDI-304827 RDM 31640
  - Mis. 19GX1-1/2 (40mm) colore crema REF BDI-301500 RDM 31654
  - Mis. 18GX1-1/2 (40mm) colore rosa REF BDI-304622 RDM 31654

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;

- CHEMIL – prodotto Needles
  - Mis. 18GX 1-1/2 (1,2x40mm) colore rosa REF 18G112 RDM 509683/R
  - Mis. 18GX 2(1,2x50mm) colore rosa REF 18G200 RDM 509684/R
  - Mis 19G X 1-1/2(1,1x40 mm) colore crema REF 19G112 RDM 509685/R
  - Mis 20GX1-1/2 (0,9X40mm) colore giallo ago n.1 REF 20G112 RDM 509686/R
  - Mis. 21GX1 (0,8x25mm) colore verde REF 21G100 RDM 509688/R
  - Mis. 21GX1-1/4 (0,8 x32 mm) colore verde REF 21G114 RDM 509689/R
  - Mis 21GX1-1/2 (0,8x40mm) colore verde ago n.2 REF 21G112 RDM 509690/R
  - Mis 22GX1-1/4 (0,7x32 mm) colore nero ago n. 12 REF 22G114 RDM 509691/R
  - Mis 23GX1 (0,6mX25mm) colore blue ago n.16 REF 23G100 RDM 509693/R
  - Mis 23GX1-1/4 (0,6X32 mm) colore blue ago n.14 REF 23G114 RDM 509694/R
  - Mis. 23GX1-1/2 (0,6x40mm) colore blue REF 23G112 RDM 509695/R
  - Mis 25GX5/8 (0,5X16 mm) colore arancio REF 25G058 RDM 509696/R
  - Mis 25GX1 (0,5x25mm) colore arancio REF 25G100 RDM 509697/R
  - Mis 26GX1/2 (0,45x13 mm) colore marrone REF 26G012 RDM 509698/R
  - Mis 26G 5/8 (0.45x16 mm) colore marrone REF26G058 RDM 509704/R

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with the number '3' in the middle, and a signature on the right.

**LOTTO N. 2 - AGHI IPODERMICI PER INIEZIONE E PRELIEVO STERILI MONOUSO CONO LUER CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:


- SMITHS MEDICAL ITALIA – prodotto Needle Pro LL
  - Mis 19GX1 1/2 REF 4282 RDM 1233564
  - Mis 19G X1 REF 4283 RDM 1233565
  - Mis 20G X1 1/2 REF 4284 RDM 1233566
  - Mis 20G X1 REF 4285 RDM 1233567
  - Mis 21G X1 1/2 REF 4286 RDM 1233568
  - Mis 21G X1 REF 4287 RDM 1233572
  - Mis. 22G X1 1/2 REF 4288 RDM 18412
  - Mis 22G X1 REF 4289 RDM 1233889
  - Mis 23G X1 REF 4290 RDM 18412
  - Mis 25GX5/8 REF 4291 RDM 18412
  - Mis 25GX1 REF 4292 RDM 18412
  - Mis 25GX1 1/2 REF 4293 RDM 18412

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- BENEFIS –
  - Mis 20GX1-1/2 colore giallo REF AS20G38 RDM 1236272
  - Mis 21GX1-1/2 colore verde REF AS21G38 RDM 1236273
  - Mis 22GX1-1/2 colore nero REF AS22G32 RDM 1236276
  - Mis 23GX1-1/4 colore blu REF AS23G32 RDM 1236277
  - Mis 25GX5/8 colore arancio REF AS25G16 RDM 1236278

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- COVIDIEN ITALIA – prodotto Monoject magellan
  - Mis. 25GX 5/8 colore arancio REF 8881850558 RDM 786567
  - Mis. 25GX1 colore arancio REF 8881850510 RDM 786565
  - Mis. 25GZ 1 ½ colore arancio REF 8881850515 RDM 786566
  - Mis. 23GX 5/8 colore blu REF 8881850358 RDM 786564
  - Mis. 23GX1 colore blu REF 8881850310 RDM 786563
  - Mis 22GX1 colore nero REF 8881850210 RDM 786561
  - Mis 22X1 ½ colore nero REF 8881850215 RDM 786562
  - Mis 21GX5/8 colore verde REF 8881850158 RDM 786560
  - Mis. 21GX1 colore verde REF 8881850110 RDM 786558
  - Mis. 21GX1 ½ colore verde REF 8881850115 RDM 786559
  - Mis. 20GX1 colore giallo REF 8881850010 RDM 786556
  - Mis. 20GX1 ½ colore giallo REF 8881850015 RDM 786557

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- RAYS – prodotto Microtip/safe
  - Mis 20GX1 colore giallo REF S-HN20G25 RDM 862635
  - Mis 20GX 1 ½ colore giallo REF S-HN20G38 RDM 682636
  - Mis 21GX1 colore verde REF S-HN21G25 RDM 862654
  - Mis 21GX11/2 colore verde REF S-HN21G38 RDM862668
  - Mis 22GX 1 ¼ colore nero REF S-HN22G32 RDM 862655
  - Mis 22Gx1 ½ colore nero REF S-HN22G38 RDM 862656
  - Mis 23GX1 colore azzurro REF S-HN23G25 RDM 862657
  - Mis 23GX1 ¼ colore azzurro REF S-HN65G30 RDM 862671
  - Mis 25GX5/8 colore arancione REF S-HN25G16 RDM 862658
  - Mis 25GX1 colore arancione REF S-HN25G25 RDM 862659

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- FARMAC ZABBAN– prodotto Farmatexa Sicurtouch
  - Mis. 20Gx1 ½ Codice 2100303501 colore giallo REF SN2015 RDM 1006946

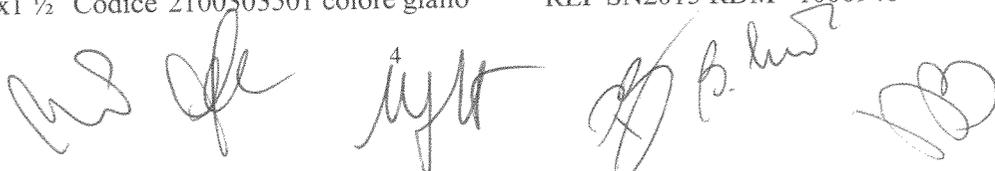

- Mis 21GX1 ½ Codice 2100303502 colore verde REF SN2115 RDM 1006946
- Mis. 22GX1¼ Codice 2100303503 colore nero REF SN22125 RDM 1006946
- Mis 23GX1¼ Codice 2100303504 colore blu REF SN23125 RDM 1006946
- Mis 23GX1 Codice 2100303505 colore blu REF SN2310 RDM 1006946
- Mis 25GX5/8 Codice 2100303506 colore arancione REF SN2558 RDM 1006946

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

- PROMED – prodotto BD Eclipse LS

- Mis. 25Gx5/8 (16mm) colore arancio REF BDI-305760 RDM 65567/R
- Mis. 23Gx1 (25mm) colore blu REF BDI-305892 RDM 65567/R
- Mis 21GX1-1/2 (40mm) colore verde REF BDI-305895 RDM 65567/
- Mis 21GX1 (25mm) colore verde REF BDI-305894 RDM 65567/R
- Mis 20GX1 (25mm) colore giallo REF BDI-305899 RDM 65567/R
- Mis 23GX 1-1/4 (30mm) colore blu REF BDI-305886 RDM 449880/R
- Mis 22GX1-1/4 (30mm) colore nero REF BDI-305887 RDM 449882/R
- Mis 25GX1 (25mm) colore arancio REF BDI-305891 RDM 449879/R

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

- CLINI-LAB – prodotto Sol Care

- Mis. 20GX1 (25mm) colore giallo REF SN2010 RDM 1198604
- Mis. 20Gx1-1/2 (40mm) colore giallo REF SN2015 RDM 1198605
- Mis. 21GX1 (25mm) colore verde REF SN 2110 RDM 1198609
- Mis. 21G1-1/2 (40mm) colore verde REF SN 2115 RDM 1198611
- Mis 22GX1 (25mm) colore nero REF SN 2210 RDM 1198613
- Mis 22GX 1-1/2 (40mm) colore nero REF SN2215 RDM 1198614
- Mis 23GX1 (25mm) colore blu REF SN2310 RDM 1198620
- Mis 23GX 1-1/2 (40mm) colore blu REF SN23125 RDM 1198622
- Mis 25GX5/8 (16mm) colore arancio REF SN2558 RDM 1198625
- Mis 25GX1 (25mm) colore arancio REF SN2510 RDM 1198627

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

### **LOTTO N. 3 - AGHI IPODERMICI STERILI MONOUSO CONO LUER**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- RAYS – prodotto Microtip/ultra

- Mis. 27GX1/2 colore grigio REF HN27G13 RDM501469
- Mis 29GX1/2 colore rosso REF HN29G13 RDM501470
- Mis. 60Gx5/16 colore giallo REF HN40G08 RDM669068
- Mis. 30GX1/2 colore giallo REF HN30G13 RDM699896

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

- PROMED – prodotto BD Micolance 3

- Mis. 27GX1/2 (13mm) colore grigio REF BDI-300635 RDM 31654/R
- Mis. 27GX3/4 (18mm) colore grigio REF BDI-302200 RDM 31654/R
- Mis 30GX1/2 (13mm) colore giallo REF BDI-304000 RDM 31654/R

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

- CLINI-LAB – prodotto NIPRO “Flomax”

- Mis. 27GX1/2 (13mm) colore grigio REF HN2713ET RDM 4619/R
- Mis. 27GX3/4 (19mm) colore grigio REF HN2719ET RDM 4620/R
- Mis. 27GX1-1/2 (38mm) colore grigio REF HN2738ET RDM 15306/R
- Mis. 30GX1/2 (13mm) colore giallo chiaro REF HN3013ET RDM 523328 /R

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

- CHEMIL – prodotto NEEDLES

- Mis. 27GX1/2(0.4x13mm) colore grigio REF 27G012 RDM 509699/R
- Mis. 27GX3/4 (0.4x19 mm) colore grigio ago n.20 REF 27G034 RDM 509700/R
- Mis. 30GX1/2 (0,3x13mm) colore giallo REF 30G012 RDM 509702/R

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

**LOTTO N. 5 - AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:


- CO.DI. SAN- prodotto TRO-VENOSET safety
  - Mis 19G colore beige REF 91701 RDM 803529
  - Mis 21 G colore verde REF 91703 RDM 803529
  - Mis 23 G colore blu REF 91705 RDM 803529conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- RAYS – prodotto Fly/Safe
  - Mis. 19GX3/4 colore crema REF S-SVS19GD RDM 589654
  - Mis. 20GX3/4 colore giallo REF S-SVS20GD RDM 589655
  - Mis. 21GX3/4 colore verde REF S-SVS21GD RDM 859656
  - Mis. 22GX3/4 colore nero REF S-SVS22GD RDM 862694
  - Mis. 23GX3/4 colore azzurro REF S-SVS23GD RDM862696conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- FARMAC ZABBAN – prodotto TRO-VENOSET Safety
  - Mis 19G Codice 2100324119 REF 91701 RDM 80898
  - Mis 21G Codice 2100324121 REF 91703 RDM 80898
  - Mis 23G Codice 2100324123 REF 91705 RDM 80898conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- CHEMIL – prodotto Safety fly
  - Mis. 19GX3/4 (1,1x19 mm) colore crema REF WS1203019 RDM 930220/R
  - Mis 20GX3/4 (0.9X19 cm) colore giallo REF WS1203020 RDM 930221/R
  - Mis 21GX3/4 (0.8X19mm) colore verde REF WS1203021 RDM 930222/R
  - Mis 22Gx3/4 (0.7X19mm) colore nero REF WS1203022 RDM 930223/R
  - Mis 23GX3/4 (0.6X16 mm) colore blu REF WS1203023 RDM 930224/Rconforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- ARTSANA – prodotto PIC MIRAGE SMARTSAFE
  - Mis G19X3/4 REF 03044019500510 RDM 958855R
  - Mis G21x3/4 REF 03044021500510 RDM 958875R
  - Mis G22X3/4 REF 03044022500510 RDM 958876R
  - Mis. G23X3/4 REF 03044023500510 RDM 958878Rconforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

**LOTTO N. 6 - AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER PRELIEVO SOTTOVUOTO E CON ADATTATORE LUER PRECONNESSO**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- CLINI-LAB- prodotto Safe Touch Blood collection set REF BCSSF2119 21GX3/4'RDM 4038/R  
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- ARTSANA- prodotto PIC VACUMIRAGE SMARTSAFE G21x3/4X7 (0.80mm x 20 mm)  
lunghezza tubo 18 cm REF 03044021180600 RDM: 1244468 conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- PROLAB – prodotto “Ago a farfalla non DEHP 21 G con luer integrato REF 450681 RDM 1246825  
la scheda tecnica non riporta la lunghezza degli aghi. La Commissione, unanimemente, si riserva di esaminare la campionatura al fine di sciogliere le riserve in ordine alla conformità del prodotto presentato.

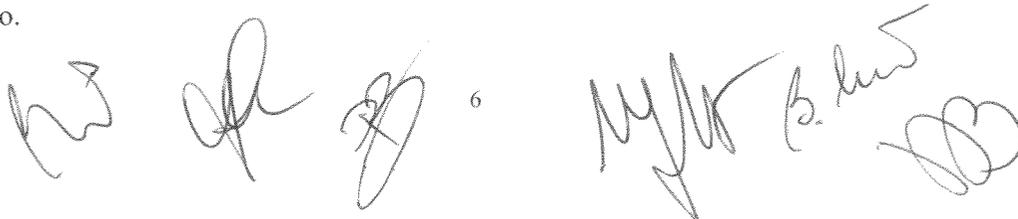

**LOTTO N. 8 - AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA DA 25G**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- RAYS – prodotto Fly/safe REF S-SVS25GD misura 25GX3/4 RDM 861394  
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- ARTSANA –prodotto “PIC MIRAGE SMARTSAFE” misura 25 GX3/4 REF 03044025500500 RDM 196257R conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

**LOTTO N. 11**

- ✓ **Sub A) PIASTRE LINEARI PER MESOTERAPIA STERILI MONOUSO MUNITE DI AGHI -**  
**Misure: piastra lineare a 3 ugelli con ago da 27 G x 4 mm**
- ✓ **Sub B) PIASTRE LINEARI PER MESOTERAPIA STERILI MONOUSO MUNITE DI AGHI -**  
**Misure: piastra lineare a 5 ugelli con ago da 27 G x 4 mm**
- ✓ **Sub C) PIASTRE CIRCOLARI MESOTERAPIA STERILI MONOUSO MUNITE DI AGHI -**  
**Misure: piastra circolare a 5 ugelli con ago da 27 G x 4 mm**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- R.I.M.O.S s.r.l. – prodotto Mesoram.
  - Sub A) REF 710201 RDM 22803
  - Sub B) REF 710205 RDM 22810
  - Sub B) REF 710203 RDM 22815

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

**LOTTO N. 13 - AGHI PER AGOPUNTURA**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.


Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- FITOCHINA ITALIA – prodotto Tony Codici
  - TA - xxxx REF 5HY-KXXXX RDM 324468
  - TAT-xxxx REF 5HY-GXXXX RDM 324557
  - TR - xxxx REF 5HD- KXXXX RDM 324554
  - TRT -xxxx REF 5HD-GXXXX RDM 324559

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

- D.B.N. STORE – prodotti TeWa Codici
  - REF CB – AR XXXX Varie misure
  - REF CB-ARs XXXX Varie misure
  - REF CJ-ART XXXX Varie misure
  - REF CJ-ARTs XXXX Varie misure
  - REF KB-AA XXXX Varie misure
  - REF JB-AL XXXX Varie misure
  - REF JJ-ALT XXXX Varie misure
  - REF PB-AP XXXX Varie misure
  - REF PJ-APT XXXX Varie misure

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

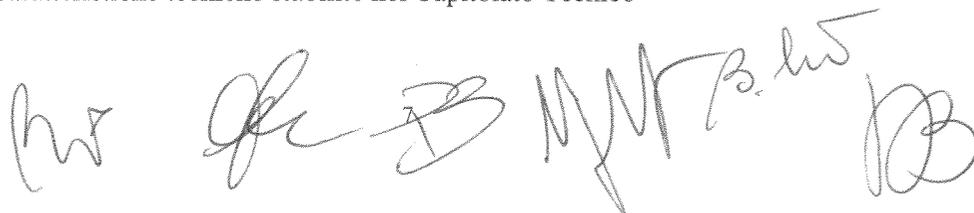

### **LOTTO N. 18 - AGHI FISTOLA PER DIALISI**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- GAMBRO HOSPAL – Nepro Corporation
  - Prodotto F15ASR G REF 106174 RDM 60289
  - Prodotto F16ASR G REF 104175 RDM 60422
  - Prodotto F15BF G REF 8501521000 RDM 60303
  - Prodotto F16BF G REF 8501621000 RDM 60313
  - Prodotto F15BS G REF 8501520100 RDM 60273
  - Prodotto F16BS G REF 8501620100 RDM 60276
  - Prodotto F17BS G REF 8501720100 RDM 60280
  - Prodotto F16AS G REF 101132 RDM 367493
  - Prodotto F15B G REF 850152000 RDM 60126
  - Prodotto F16B G REF 8501620000 RDM 60197
  - Prodotto F17B G REF 8501720000 RDM 60268
  - Prodotto F16BFS G REF 8501621100 RDM 60335

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

### **LOTTO N. 20 - AGHI PER GALATTOGRAFIA**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- HS HOSPITAL SERVICE – prodotto REF GK30 RDM 84270  
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

### **LOTTO N. 21 - AGHI TRANSETTALI**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- COOK ITALIA S.R.L. – prodotto Codice TSNC-18-71.0 “BROCKENBROUGH” e TSNC 19-56.0 entambi con RDM 215146.: conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico


### **LOTTO N. 22 - DISPOSITIVI MULTIPRELIEVO**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- FERRARI L. DI FERRARI PIETRO s.r.l – Prodotto codice FD0008913-LLFBC RDM 257235
- BTC MEDICAL EUROPE – prodotto Codice 4045 RDM 67035  
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- CODAN REF 165260 RDM 68740  
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- CAIR ITALIA– prodotto Extra Spike plus verde RDM 2902802 REF 42607  
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- COVIDIEN ITALIA – prodotto Monoject REF 8881305117 RDM 170336  
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

8

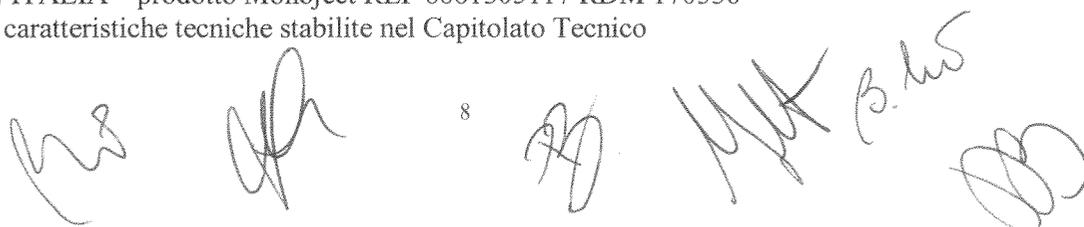

- MULTIMEDICAL – prodotto Spike 2 Ref 091529 RDM 225961  
la scheda tecnica non riporta la misura del filtro. La Commissione, unanimemente, si riserva di esaminare la campionatura al fine di sciogliere le riserve in ordine alla conformità del prodotto presentato.

**LOTTO N. 23 - DISPOSITIVO MULTIPRELIEVO PER ANTIBLASTICI**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- **VERSAN & DAFNE M.D. S.R.L. DAFNE**
  - Sub a) prodotto "Clave" Codice CS-51 RDM 489083: conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
  - Sub b) prodotto "Clave" Codice CH-72 RDM 488850: conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- **L. DI FERRARI PIETRO s.r.l –**
  - Sub a) prodotto Codice FD0008913-IBC / RDM 257235. La scheda tecnica riporta l'indicazione di filtri da 0.45 micron mentre il capitolato prescriveva filtri da 0,22 micron. La Commissione, unanimemente, si riserva di esaminare la campionatura al fine di sciogliere le riserve in ordine alla conformità del prodotto presentato.
  - Sub b) prodotto Codice FD0008913-IMINIBC RDM 257235;
- **CARE FUSION 311 – prodotto SmarSite. conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico**
  - Sub a) SmartSite REF MV0420-0006
  - Sub b) SmartSite REF MV0413-0006
- **BTC MEDICAL EUROPE:**
  - Sub a) e sub b) la ditta presenta il prodotto codice REF 4027 / RDM 67035.  
La scheda tecnica riporta l'indicazione di filtri da 0.1 micron mentre il capitolato prescriveva filtri da 0,22 micron. La Commissione, unanimemente, si riserva di esaminare la campionatura al fine di sciogliere le riserve in ordine alla conformità del prodotto presentato.
- **CODAN –**
  - Sub A) REF 165290 RDM 68740
  - Sub B) REF 165297 RDM 490216  
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- **CAIR ITALIA–**
  - Sub A) ExtraSpike chemoplus rosso REF 2902822 RDM 42643
  - Sub B) Microspike a 2 vie con filtro antibatterico REF 2000809 RDM 101814  
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- **MULTIMEDICAL –**
  - Sub a) prodotto Spike 2 needleless REF 091565/1 RDM 1243883
  - Sub b) prodotto minispike needleless REF 091570/1 RDM 1243884  
conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

**LOTTO N. 24 - SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI DA TUBERCOLINA CON AGO STACCABILE**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- **BENEFIS –**
    - REF 01261500 misura 26 G RDM 216055
    - REF 01271500 misura 27 G RDM 216057
- la scheda tecnica non riporta la lunghezza degli aghi;

Handwritten signatures and initials, including what appears to be 'B. h. 5' and a circular stamp.

- NACATUR – prodotto Caress Codice CCAR00101025 RDM 1064166: la scheda tecnica non riporta la lunghezza degli aghi.

La Commissione, unanimemente, si riserva di esaminare la campionatura al fine di sciogliere le riserve in ordine alla conformità dei prodotti presentati dalle ditte precitate;

**LOTTO N. 25 - SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI DA TUBERCOLINA CON AGO STACCABILE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- BENEFIS – prodotto REF 0126150S RDM 1236285: la scheda tecnica non riporta la lunghezza degli aghi. La Commissione, unanimemente, si riserva di esaminare la campionatura al fine di sciogliere le riserve in ordine alla conformità del prodotto presentato.

**LOTTO N. 26 - SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI CON AGO**

✓ Sub A) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI CON AGO

✓ Sub B) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI CON AGO

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- BENEFIS

- Sub A) REF 25221500 RDM 53102
- Sub B) REF 50221500 RDM 53108

la scheda tecnica non riporta la lunghezza degli aghi. La Commissione, unanimemente, si riserva di esaminare la campionatura al fine di sciogliere le riserve in ordine alla conformità del prodotto presentato.

- RAYS – prodotto Inj/light

- Sub A) REF 2522CM32 RDM 642698
- Sub B) REF 5522CM32 RDM 269869

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

- FARMAC ZABBAN – prodotto Farmatexa softouch

- Sub A) REF 2102690003 RDM 160364
- SUB B) REF 2102690004 RDM 160364

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

- NACATUR – prodotto Caress

- Sub A) Ref CCAR 00251045 RDM 1063891
- Sub B) Ref CCAR 00501045 RDM 1063887

la scheda tecnica non riporta la lunghezza degli aghi. La Commissione, unanimemente, si riserva di esaminare la campionatura al fine di sciogliere le riserve in ordine alla conformità del prodotto presentato.

**LOTTO N. 27 - SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO**

✓ Sub A) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO – Misure siringhe da 2 - 2,5 ml cono centrale luer

✓ Sub B) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO – Misure siringhe da 5 ml cono centrale/eccentrico luer

- ✓ **Sub C) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO** – Misure siringhe da 10 ml cono eccentrico/centrale luer
- ✓ **Sub D) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO** – Misure siringhe da 20 ml. cono eccentrico luer
- ✓ **Sub E) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO** – Misure siringhe da 30 ml. cono eccentrico luer
- ✓ **Sub F) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO** – Misure siringhe da 50 ml cono eccentrico luer

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- **BENEFIS** –
  - Sub A) REF 03BLFL RDM 442141
  - Sub B) REF 05BLFL RDM 216036
  - Sub C) REF 10BLFL RDM 216037
  - Sub D) REF 20BLFL RDM 216038
  - Sub E) REF 30BLFL RDM 216040
  - Sub F) REF 60BLFL RDM 53132

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- **RAYS** – prodotto Inj/light
  - Sub A) REF 22LC RDM 1071886
  - Sub B) REF 55LC RDM 674888
  - Sub C) REF 10LE RDM 671847
  - Sub D) REF 20LE RDM 674851
  - Sub E) REF 30LE RDM 674867
  - Sub F) REF 60LE RDM 674887

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- **NACATUR** – prodotto Caress
  - Sub A) REF CCAR01002000 RDM 1064266
  - Sub B) REF CCAR00501000 RDM 1025608
  - Sub C) REF CCAR01002000 RDM 377115
  - Sub D) REF CCAR02002000 RDM 377104
  - Sub E) REF CCAR03002000 RDM 1063988
  - Sub F) REF CCAR05002000 RDM 377106

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

**LOTTO N. 28 - SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO CATETERE**

- ✓ **Sub A) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO CATETERE** – Misure siringhe da 50/60 ml cono catetere non a becco di flauto
- ✓ **Sub B) SIRINGHE INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO CATETERE** – Misure siringhe da 100 ml cono catetere non a becco di flauto

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- **BENEFIS** –
  - Sub A) REF 60BLFLCC RDM 53138
  - Sub B) REF 100BLFLCC RDM 232955

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico
- **RAYS** – prodotto Inj/light
  - Sub A) REF 60CC RDM 674767
  - Sub B) REF 100CC RDM 671867

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with '11' above it in the center, and several other signatures on the right.



Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

• **BENEFIS** –

- REF 03BLFLLL RDM 216046
- REF 05BLFLLL RDM 216045
- REF 10BLFLLL RDM 216044
- REF 20BLFLLL RDM 216043
- REF 30BLFP LL RDM 359590
- REF 60BLFP LL RDM 216050
- REF 60BLFPSL RDM 387193

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

• **RAYS** – prodotto inj/light

- REF 33LL RDM 671748
- REF 55LL RDM 674787
- REF 10LL RDM 674788
- REF 20LL RDM 674789
- REF 30LL RDM 674790
- REF 60LL RDM 674793
- REF 50LLFT RDM 674810

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

• **NACATUR** – prodotto Caress

- REF CCAR00253000 RDM 1063948
- REF CCAR00503000 RDM 1063952
- REF CCAR01003000 RDM 1063954
- REF CCAR02003000 RDM 1063966
- REF CCAR03008000 RDM 1063967
- REF CCAR05008000 RDM 1063969
- REF CCAR05008000A RDM in via di registrazione

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

**LOTTO N. 31 - SIRINGA PRERIEMPITA PER LAVAGGIO ACCESSI VENOSI CENTRALI**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- **VYGON ITALIA** – presenta il prodotto Praxiject 10 ml Codice 58000003705C REF 3705C RDM 1147000 :
- **PROMED** – presenta il prodotto BD-PosiFlushSP 10 ml REF BDI-306575 RDM 265907/R: conforme alle
- **CLINI-LAB** – presenta il prodotto MEDISP REF 363 RDM (in fase di registrazione)

**LOTTO n. 32**


- ✓ **SUB A) SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI** - Misure: siringhe da 1 ml circa di tipo pediatrico, cono centrale luer ago 25 G – circa 13 mm
- ✓ **SUB B) SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI** - Misure: siringhe da 2,5 – 3 ml di tipo adulti, cono centrale luerlock ago 22/23 G – circa 25 mm

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

- **GEPA** – prodotto Westmed Pullset
  - Sub A) codice 70P135 REF 3105 RDM 163019

13

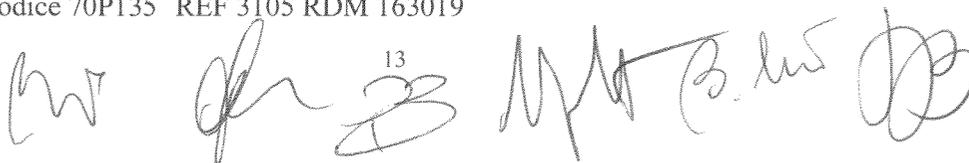

o SUB B) codice 70P320 -70P335 REF 3302-50 – 3303-50RDM 163019

La scheda tecnica non riporta la lunghezza degli aghi.

La Commissione, unanimemente, si riserva di esaminare la campionatura al fine di sciogliere le riserve in ordine alla conformità del prodotto presentato.

• SMITHS MEDICAL ITALIA–

o Sub A) prodotto Provent Plus REF 4618PE RDM 59026

o Sub B) prodotto Provent Plus REF 4558PE RDM 59023

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico

• CLINI-LAB –

o Sub a) prodotto Micro GAS Lyte REF 9025RH RDM 93921/R

o Sub b) prodotto GAS LYTE REF 40XXLRH (dove xx = 22/23G) RDM 95342/R

La scheda tecnica non riporta la lunghezza degli aghi.

La Commissione, unanimemente, si riserva di esaminare la campionatura al fine di sciogliere le riserve in ordine alla conformità del prodotto presentato.

**LOTTO n. 33**

✓ **SUB A) SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA** - Misure: siringhe da 1 ml circa di tipo pediatrico, cono centrale luer ago 25 G – circa 13 m

✓ **SUB B) SIRINGA STERILE MONOUSO CON AGO PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA** - Misure: siringhe da 2,5 – 3 ml di tipo adulti, cono centrale luerlock ago 22/23 G – circa 25 mm

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

• GEPA – prodotto Westmed pulset Cricket

o Sub A) Codice 70P135S

REF 3105-95

RDM 1057131

o Sub B) Codice 70P320S/90P335S

REF 3312-95/3313-95

RDM

La scheda tecnica non riporta la lunghezza degli aghi.

La Commissione, unanimemente, si riserva di esaminare la campionatura al fine di sciogliere le riserve in ordine alla conformità del prodotto presentato

• SMITHS MEDICAL ITALIA – prodotto Pro-vent Plus

o Sub A) REF 4619PG RDM 1132845

o SUB B) REF 4558PG RDM 1130977

conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

Alle ore 13,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori al giorno 11/02/2015 alle ore 9,00 presso la sede del Magazzino Economale della AO di Padova, situato in V.le Navigazione Interna n. 38 – Padova, ove sono custoditi i campioni presentati dalle Ditte, per procedere con la valutazione qualitativa dei prodotti ammessi, Lotto per Lotto, desumibile dalla documentazione tecnica e dai campioni presentati, secondo i parametri di valutazione previsti nell'Allegato 6 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Dott.ssa Daniela Barzan

I COMPONENTI: Sig.ra Paola Battanolli

Sig.ra Bertilla Ranzato


Sig. Franco Martinello

The image shows three handwritten signatures on horizontal lines. The first signature is 'D. Barzan', the second is 'Paola Battanolli', and the third is 'Bertilla Ranzato'. There is a fourth signature below the others, which is less legible but appears to be 'Franco Martinello'.

IL SEGRETARIO:

Sig. Nicola Galtarossa

Dott.ssa Roberta Padovan

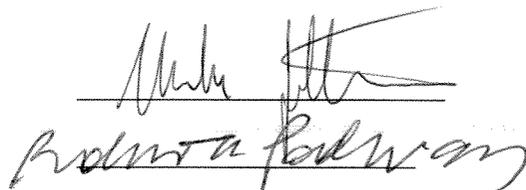

Handwritten signatures of Nicola Galtarossa and Roberta Padovan. The signature of Nicola Galtarossa is written above a horizontal line, and the signature of Roberta Padovan is written below it.

